

1 Pour votre sécurité

1.1 Indications générales de sécurité

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la Notice d'utilisation.
- Respectez scrupuleusement la Notice d'utilisation. L'utilisateur doit comprendre et suivre à la lettre la totalité des instructions. Veuillez utiliser ce produit exclusivement aux fins spécifiées dans le chapitre Usage prévu du présent document.
- Ne jetez pas cette Notice d'utilisation. Veuillez-vous assurer que l'utilisateur de ce produit la conserve et l'utilise de façon conforme.
- Seuls les utilisateurs dûment formés et compétents sont autorisés à utiliser ce produit.
- Respectez toutes les règles et réglementations locales et nationales relatives à ce produit.
- Seul le personnel formé et compétent est autorisé à inspecter, réparer et assurer la maintenance de ce produit. Dräger recommande de souscrire un contrat de service avec Dräger pour tous les travaux de maintenance et de confier toutes les réparations à Dräger.
- Le personnel technique dûment formé doit inspecter ce produit et assurer sa maintenance, comme indiqué dans les instructions du chapitre Maintenance du présent document.
- Utilisez uniquement des pièces détachées et des accessoires originaux Dräger, sans quoi le fonctionnement correct du produit pourrait être compromis.
- Veuillez ne pas utiliser de produit défectueux ou incomplet, et ne pas modifier le produit.
- Veuillez informer Dräger de toute défaillance ou de tout défaut des composants.
- Avant l'utilisation professionnelle de ce respirateur, un programme écrit de protection respiratoire doit être mis en place et répondre à toutes les exigences gouvernementales locales. Aux États-Unis, les employeurs doivent se conformer à la norme OSHA 29 CFR 1910.134 qui comprend l'évaluation médicale, la formation et le contrôle d'étanchéité (fit test).

1.2 Définitions des symboles d'alerte

Des symboles d'avertissement sont utilisés dans le présent document afin de mettre en évidence le texte qui requiert une plus grande attention de la part de l'utilisateur. Les symboles d'avertissement sont définis comme suit :

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer la mort ou des blessures sérieuses.

⚠ ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures physiques à votre personne ou des dégâts au produit ou à l'environnement. Peut également être utilisé pour avertir d'une utilisation incorrecte.

REMARQUE

Indique des informations supplémentaires relatives à l'utilisation de l'appareil.

2 Description

2.1 Vue générale de l'équipement

Cette version du modèle Dräger PAS® Colt offre une protection respiratoire pour évacuer un environnement contaminé au moyen d'air respirable provenant de la bouteille (appareil respiratoire autonome - SCBA).

Les fonctions de l'équipement sont :

- Le système de transport se compose d'un harnais en bandoulière et d'un ceinturon.
- La soupape à la demande (LDR) dispose d'un bouton de réinitialisation (Fig. 1, Élément 1) qui coupe le passage de l'air à travers la soupape, et un bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) qui peut servir à purger le système pneumatique. Le support (Fig. 2, Item 1) Élément 1) offre un point d'arrimage pour éviter que le raccordement de la soupape et le joint torique s'abiment lorsqu'ils ne sont pas montés dans le masque facial.
- Le détendeur premier étage (Fig. 2, Élément 2) est équipé d'une sangle anti-vibrations qui permet d'empêcher que la molette du connecteur se relâche.
- Le porte-bouteille monté sur la hanche est équipé d'un système rabattable qui facilite les mouvements de l'utilisateur en rendant la bouteille et le porte-bouteille plus manœuvrables (dans un espace confiné par exemple).
- La pression restant dans la bouteille d'air est indiquée sur une jauge de niveau installée sur la bouteille.
- Une sangle de cuisse est disponible en tant qu'accessoire.










2.2 Utilisation prévue

Quand ce produit est utilisé avec un masque facial et une bouteille d'air homologués, il fournit à l'utilisateur la protection respiratoire lui permettant d'évacuer un lieu contaminé ou pauvre en oxygène. Il est destiné à être utilisé dans les applications où un niveau élevé de protection respiratoire est requis, notamment dans des atmosphères dangereuses pour la santé et mortelles (IDLH).

La bouteille d'air, le masque facial et les autres accessoires utilisés avec cet équipement doivent être des composants Dräger homologués, assemblés dans une configuration approuvée, sans quoi le fonctionnement de l'appareil peut en être affecté. Il est essentiel que les masques faciaux avec purge, les masques faciaux sans purge et les soupapes à la demande ne soient pas mélangés (c'est-à-dire que seuls les masques faciaux avec purge doivent être utilisés avec des soupapes à la demande avec purge). Contacter Dräger pour de plus amples informations.

2.3 Restrictions d'utilisation

Ce produit n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les applications CBRN.

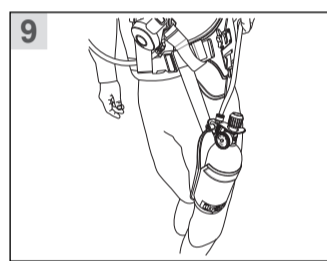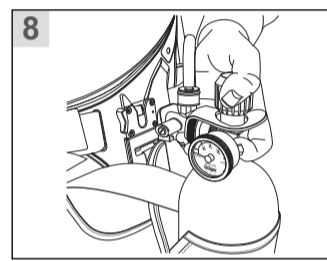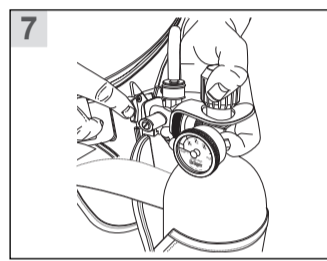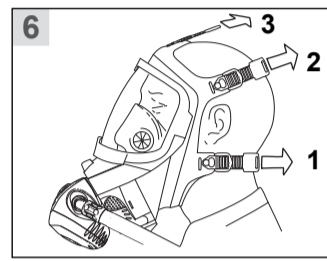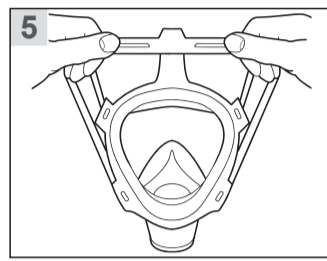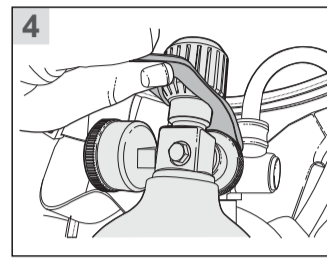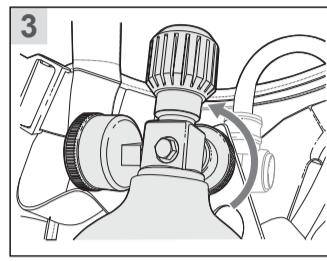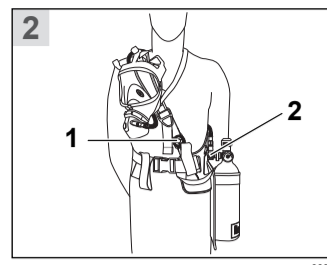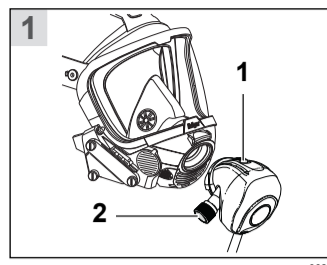

2.4 Homologations

Le modèle PAS® Colt est un équipement de protection respiratoire d'évacuation conforme aux exigences de NIOSH. Ce produit est homologué pour être utilisé en tant que respirateur d'évacuation autonome et doit être uniquement employé avec des bouteilles d'air comprimé approuvées NIOSH.

3 Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Le temps nécessaire pour permettre à l'utilisateur de rejoindre une zone sûre doit correspondre à la capacité (volume) de la bouteille sélectionnée en tenant compte de la fréquence respiratoire de l'utilisateur. Lorsque vous sélectionnez le type d'équipement d'évacuation et la durée d'évacuation, il est essentiel de prendre en compte les risques potentiels et les issues de secours possibles.

La qualité de la source d'air doit satisfaire aux exigences applicables à l'air respirable selon CGA G-7.1, niveau D ou plus.

3.1 Préparation à l'utilisation

3.1.1 Inspection visuelle

Effectuer une inspection visuelle en vérifiant l'intégralité du dispositif respiratoire, y compris toutes ses composantes et accessoires. Vérifier que l'équipement est propre et non endommagé, en attachant une attention particulière aux composants pneumatiques, aux tuyaux et aux connecteurs. Des signes habituels d'endommagement qui peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil respiratoire comprennent des traces de coup, d'abrasion, de coupure, de corrosion et de décoloration. Notifier tout dommage au personnel technique et s'abstenir d'utiliser l'appareil jusqu'à rectification des défauts.

3.1.2 Mise en place de la bouteille

1. S'assurer que la bouteille est entièrement chargée avec le pointeur du manomètre dans la zone verte.
2. Vérifier que le filetage du port de la valve et la molette du détendeur ne sont pas endommagés et que le joint torique est en position et n'est pas détérioré.
3. Insérer complètement la bouteille dans le porte-bouteille.

⚠ ATTENTION

Pour éviter tout dommage, s'assurer que la molette du détendeur premier étage ne touche pas la bouteille lorsque vous insérez celle-ci.

4. Aligner la bouteille sur le détendeur et serrer fermement la molette (Fig. 3).
5. Tirer la sangle anti-vibrations par-dessus le robinet de la bouteille (Fig. 4).

3.1.3 Test fonctionnel

⚠ AVERTISSEMENT

Si l'appareil respiratoire ne remplit pas les exigences ou les paramètres décrits dans le test fonctionnels, ou si une fuite est évidente, il y a défaut du système. Veuillez signaler la défaillance au personnel technique formé ou contacter Dräger. Veuillez ne pas utiliser l'appareil respiratoire jusqu'à réparation du défaut.

Test d'étanchéité

1. Vérifier que le pointeur du manomètre de la bouteille est dans la zone verte.
2. Appuyer sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1, Élément 1) de la soupape à la demande pour désactiver la pression positive.
3. Ouvrir lentement le robinet de la bouteille, mais complètement, pour pressuriser le système, puis fermer le robinet. On ne doit pas entendre de fuite. S'il y a une fuite, la rechercher et la réparer avant utilisation. Si nécessaire, utiliser une solution savonneuse pour localiser la fuite.
4. Appuyer sur le bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) pour purger le système.
5. Appuyer sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1, Élément 1) pour désactiver la pression positive.

3.1.4 Mettre le PAS® Colt (position prêt à l'emploi)

Voir également la Fig. 2 qui représente le PAS® Colt porté en position prêt à l'emploi.

1. Vérifier que le pointeur du manomètre de la bouteille est dans la zone verte.
2. Ouvrir la boucle du ceinturon et étendre complètement le ceinturon et la bretelle.
3. Placer le bras gauche à travers le harnais d'épaule en tenant le harnais au-dessus de votre tête et sur l'épaule droite, en positionnant la sangle en diagonale sur le corps avec la bouteille contre la hanche gauche.
4. Faire passer la sangle autour de la taille et fermer la boucle - ne pas serrer.
5. Saisir le robinet de la bouteille avec la main gauche et le soulever jusqu'à ce que le ceinturon soit aligné avec la taille. Puis serrer le ceinturon jusqu'à ce que l'équipement soit bien attaché et confortable sur la poitrine. Tirer la bretelle vers le bas pour l'ajuster.
6. Inspecter le masque facial comme décrit dans les Instructions d'Utilisation.
7. Vérifier si le port du masque facial et le joint torique du régulateur sont propres et ne sont pas endommagés.
8. Retirer la soupape à la demande du support et l'insérer dans le port du masque facial jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Vérifier la fixation en essayant de tirer doucement sur l'accouplement.
9. Mettre le serre-nuque du masque par-dessus la tête puis insérer la sangle de nuque dans le trou dans la bride centrale du serre-tête.

3.2 Pendant l'utilisation

3.2.1 Mise en place du masque facial et procédure d'évacuation

⚠ AVERTISSEMENT

Le port correct du masque n'est garanti que si le joint du masque est entièrement en contact avec la peau. Les cheveux, les poils de barbe (y compris barbe de trois jours et favoris), les boucles d'oreille ou autre piercings et els lunettes de vue interfèrent avec le joint du masque et ne sont pas autorisés dans la zone du joint. De plus, les cheveux susceptibles de nuire à l'étanchéité du masque (chignons, queues de cheval, postiches, etc.) ne sont pas autorisés.

REMARQUE

Consulter également la Notice d'utilisation du masque facial.

1. Appuyer sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1, Élément 1) de la soupape à la demande pour arrêter la pression positive.
2. Ouvrir lentement le robinet de la bouteille (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre), mais complètement, de manière à pressuriser le système.

REMARQUE

Après un stockage à des températures inférieures à 32 32 °F (0 °C) une fuite peut être observée à la première ouverture du robinet de la bouteille à cause de la formation de glace.

- Si une fuite est constatée au niveau de la soupape à la demande : Appuyer sur le bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) pour laisser entrer de l'air dans la soupape à la demande, puis appuyer rapidement sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1, Élément 1) pour arrêter la pression positive. Reprendre le fonctionnement normal.
- S'il existe toujours une fuite, l'appareil respiratoire ne doit plus être utilisé et la défaillance doit être signalée au personnel technique formé ou à Dräger.

3. Détacher le tenon du serre-nuque de la bride centrale du serre-tête.
4. Étendre le serre-tête (Fig. 5). Placer le menton dans la mentonnière du masque et tirer le serre-tête par-dessus la tête en plaçant la plaque centrale du serre-tête sur l'arrière de la tête.
5. Comme indiqué sur la Fig. 6, serrer les brides inférieure (1) et supérieure (2) de manière égale sur l'arrière de la tête. Si nécessaire, serrer la bride centrale (3). La première inspiration de l'utilisateur après avoir mis le masque sur le visage de manière étanche déclenchera automatiquement la source d'air dans le masque facial.

⚠ AVERTISSEMENT

La durée d'alimentation en air commence au moment de l'activation de la soupape à la demande par la première respiration.

Dräger déconseille vivement d'utiliser le bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) pendant une évacuation. L'utilisation du bouton de purge consommerait l'air de la bouteille et réduirait le temps d'évacuation disponible.

6. Quitter immédiatement la zone dangereuse par la voie la plus courte et la plus sûre.

L'utilisateur doit être en mesure d'atteindre la zone voulue avant que la bouteille soit vide. Une fois en zone sûre, retirer la soupape à la demande du masque si nécessaire et continuer à respirer normalement.

3.2.2 Porte-bouteille rabattable

- Pour ouvrir le porte-bouteille rabattable :
 - Tenir le robinet de la bouteille de la main gauche et, avec la main droite, appuyer et maintenir enfoncé le bouton rouge pour ouvrir le mécanisme de verrouillage (Fig. 7).
 - Soulever la bouteille et le porte-bouteille à distance du mécanisme de verrouillage, puis relâcher le bouton rouge (Fig. 8).
 - Abaisser la bouteille jusqu'à ce qu'elle soit soutenue par les sangles du harnais (Fig. 9). Le porte-bouteille est maintenu par deux sangles : l'une fixe et l'autre réglable.
 - Tenir le robinet de la bouteille pour déplacer la bouteille et le porte-bouteille si nécessaire.
- Pour rebrancher le porte-bouteille rabattable, aligner le rouleau sur le porte-bouteille et l'insérer dans le mécanisme de verrouillage.

3.3 Après utilisation

AVERTISSEMENT

Ne pas retirer l'équipement avant d'être dans un endroit sûr, sans danger.

ATTENTION

Ne pas laisser tomber le SCBA, il pourrait être endommagé.

- Desserrer les sangles du masque. Si le joint entre le masque et le visage est rompu, appuyer sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1, Élément 1) pour désactiver la pression positive.
- Retirer le masque et étendre complètement toutes les brides du serre-tête.
- Fermer le robinet de la bouteille.
- Appuyer sur le bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) pour purger complètement le système.
- Retirer la soupape à la demande du masque facial et l'accrocher au support (Fig. 2, Élément 1).
- Défaire la boucle du ceinturon, soulever la boucle de la bretelle pour libérer le harnais, puis retirer l'équipement.
- Effectuer les tâches d'entretien nécessaires après une utilisation, comme indiqué dans le tableau de maintenance (voir Section 5.1).

4 Résolution des problèmes

Le guide de résolution des problèmes indique un diagnostic d'erreur et les informations de réparation applicables aux utilisateurs d'appareils respiratoires. Des informations supplémentaires relatives à la résolution des problèmes et aux réparations sont disponibles dans la Notice d'utilisation fournie avec l'équipement correspondant (p. ex. : masque facial).

Contactez le personnel technique ou Dräger lorsque les informations de réparation indiquent une opération technique ou si le problème persiste après la réalisation de toutes les opérations de réparation.

Problème	Défaillance	Solution
Fuite d'air à haute pression ou test d'étanchéité incorrect	Connecteur mal fixé ou sale Tuyau ou composant défectueux	Déconnecter, nettoyer et reconnecter les raccords et effectuer de nouveau le test Substituer les accessoires remplaçables par l'utilisateur et effectuer un nouveau test
Fuite d'air au niveau de la soupape à la demande	Particules de glace sur les éléments de joint	Appuyer sur le bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) pour laisser entrer de l'air dans la soupape à la demande, puis appuyer rapidement sur le bouton de réinitialisation (Fig. 1 Élément 1) pour arrêter la pression positive.
Fuite d'air du raccord du tuyau de moyenne pression au niveau du détendeur premier étage (soupape de sécurité)	Joint torique, élément de retenue, ressort ou détendeur premier étage défectueux	Opération technique
Moyenne pression trop haute ou trop basse	Détendeur premier étage défectueux	Opération technique

5 Maintenance

5.1 Tableau de maintenance

Veillez entretenir et tester l'appareil respiratoire, y compris l'équipement de réserve, conformément au tableau de maintenance. Enregistrez toutes les informations de maintenance et de tests. Se reporter également aux Instructions d'utilisation pour la soupape à la demande, le masque et les autres équipements correspondants.

Des contrôles et tests supplémentaires peuvent être nécessaires dans le pays d'utilisation afin d'assurer la conformité avec la législation nationale.

Contrôle quotidien – Si le PAS® Colt est conservé dans un état prêt à l'emploi, vérifier chaque jour que le pointeur du manomètre de la bouteille est dans la zone verte. Recharger la bouteille s'il est dans la zone rouge (voir Section 5.2.2).

Composants / système	Tâche	Avant utilisation	Après utilisation	Tous les mois	Tous les ans	Tous les 10 ans
Équipement complet	Inspection visuelle (voir Remarque 1 et Section 3.1.1)	○	○	○		
	Test fonctionnel (voir Section 3.1.3)		○	○		
	Cycle respiratoire et tests statiques (voir Remarque 2)					○
Soupape à la demande	Contrôler la lubrification des connecteurs à encliqueter (voir Remarque 3)	○				

Composants / système	Tâche	Avant utilisation	Après utilisation	Tous les mois	Tous les ans	Tous les 10 ans
Détendeur premier étage	Vérification de pression moyenne (voir Remarque 2)				○	
	Inspecter le filtre fritté (voir Remarque 2 et Remarque 4)				○	
	Inspecter le joint torique du connecteur haute pression (voir Note 2 et Note 5)				○	
	Révision générale. Contacter Dräger pour le Service réparation/substitution (REX) (voir Remarque 6)					○
Bouteille	Charger la bouteille à la bonne pression de service (voir Section 5.2.2)		○			
	Vérifier la pression chargée (uniquement les bouteilles entposées)				○	
	Vérifier la date du test de la bouteille (les bouteilles en carbone composite de plus de 15 ans doivent être réformées)				○	
	Renouvellement de la certification					En conformité avec les réglementations nationales du pays d'utilisation
Robinet de la bouteille	Révision générale					Au renouvellement de la certification de la bouteille

Remarques

○ Recommandations de Dräger

- Nettoyer l'équipement s'il est encrassé. Si l'équipement a été exposé à des substances toxiques, désinfecter tous les composants qui entrent en contact direct et prolongé avec la peau.
- Ces opérations de maintenance peuvent uniquement être effectuées par Dräger ou par un personnel technique dûment formé. Le détail de ces tests figure dans le manuel technique remis au personnel ayant suivi un cours de formation à la maintenance de Dräger.
- Vous devriez ressentir le lubrifiant sur les doigts sans le voir. Si une nouvelle lubrification est nécessaire, appliquer légèrement du Dow Corning® Molykote® 111 (les autres lubrifiants n'ont pas été testés et peuvent endommager l'équipement).
- Remplacer le filtre fritté si vous constatez une baisse de la performance du régulateur premier étage au cours de la vérification de l'écoulement ou s'il est visiblement endommagé.
- Veillez remplacer le joint torique du connecteur à haute pression s'il est visiblement endommagé ou si vous constatez une fuite pendant le test fonctionnel.
- Lorsque l'appareil respiratoire est soumis à un usage intensif (dans des établissements de formation, etc. par exemple), une réduction des intervalles d'inspection du régulateur premier étage. Dans ces circonstances, Dräger recommande une fréquence d'inspection inférieure à 5 000 applications d'utilisation. Une application d'utilisation est définie comme une utilisation simple de l'appareil respiratoire complètement assemblé, l'utilisateur respirant à partir d'une bouteille d'air. Elle ne comprend pas la pressurisation du système pour des contrôles pré-opératoires.

5.2 Travaux de maintenance

5.2.1 Retirer la bouteille

AVERTISSEMENT

La libération d'air à haute pression peut causer des blessures chez l'utilisateur ou les autres personnes se trouvant à proximité de l'équipement respiratoire. Fermer la soupape de la bouteille et purger totalement le système avant de tenter toute déconnexion de la bouteille d'air comprimé.

- Fermer le robinet de la bouteille et appuyer sur le bouton de purge (Fig. 1, Élément 2) pour purger complètement le système.
- Retirer la sangle anti-vibrations du robinet de la bouteille (Fig. 4).
- Déconnecter le robinet de la bouteille du détendeur premier étage.
- Enlever soigneusement la bouteille du porte-bouteille. Pour éviter tout dommage, s'assurer que la molette du détendeur premier étage n'entre pas en contact avec la bouteille.

5.2.2 Chargement en air de la bouteille

AVERTISSEMENT

La qualité de l'air des bouteilles à air comprimé doit être conforme aux exigences de qualité minimales pour l'air gazeux de type 1 tel que défini dans la spécification CGA relative à l'air, G-7.1, qualité D ou qualité supérieure.

Si l'humidité contenue dans l'air dépasse le niveau recommandé, des particules de glace peuvent se former, ce qui peut réduire ou entraver le débit d'air. La teneur en eau de l'air doit être vérifiée dans tout contenant.

- Se référer également aux instructions fournies avec la bouteille et l'unité de chargement pour le rechargement de la bouteille.
- Ne remplir que les bouteilles d'air comprimé qui :
 - Sont conformes aux normes nationales.
 - Portent la mention de la date de test du fabricant et de la marque du test.
 - N'ont pas dépassé la date de test indiquée sur la bouteille lors du dernier test.
 - Ne sont pas endommagées.
- Pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la bouteille, s'assurer que le robinet de la bouteille reste fermé jusqu'à ce qu'elle soit connectée à l'unité de charge.
- Recharger à la pression de fonctionnement nominale de la bouteille. Dräger recommande une vitesse de charge de 300 psi/minute. Un chargement rapide augmentera la température, ce qui empêchera la

charge complète. Revérifier à température ambiante et rajouter de l'air si nécessaire.

- Pour éviter de surcharger la bouteille, Dräger recommande d'utiliser un appareil de limitation de pression sur le compresseur de charge.

5.3 Nettoyage et désinfection

ATTENTION

De l'eau et de la glace coincées dans le système pneumatique (comme dans la soupape à la demande) peuvent gêner le fonctionnement de l'appareil respiratoire.

- Empêcher tout liquide de pénétrer à l'intérieur du système pneumatique, et sécher complètement l'appareil respiratoire après l'avoir nettoyé et désinfecté.

L'utilisation de méthodes de nettoyage et de désinfection non décrites dans la présente section pourrait endommager l'équipement.

- Ne pas dépasser 60 °C (140 °F) de séchage et retirer les composants du séchoir immédiatement après le séchage. La durée de séchage dans la chambre de séchage chauffée ne doit pas dépasser 30 minutes.
- Veillez ne pas plonger les composants pneumatiques ou électroniques dans des solutions de nettoyage ou dans de l'eau.



Pour plus d'informations sur les agents de nettoyage et de désinfection appropriés et leurs spécifications, se reporter au document 9100081 sur www.draeger.com/IFU.

Veillez vous reporter également à la notice d'utilisation pour la soupape à la demande, le masque et les autres équipements correspondants.

- Utiliser uniquement des chiffons non pelucheux.

- Nettoyer manuellement l'appareil respiratoire à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution propre pour enlever le surplus de saleté.
- Appliquer une solution désinfectante sur toutes les surfaces internes et externes.
- Rincer abondamment à l'eau propre tous les composants pour enlever les agents de nettoyage et de désinfection.
- Sécher tous les composants au moyen d'un chiffon sec, d'une armoire de séchage chauffée ou à l'air libre.
- Contactez le personnel technique ou Dräger s'il s'avère nécessaire de démonter les composants pneumatiques ou électroniques.

6 Stockage

Stocker l'équipement à une température comprise entre 5 °F et 77 °F (-15 °C et +25 °C). S'assurer que l'environnement est sec, exempt de poussière et de saleté, et qui ne l'expose pas à l'usure ou au dommage causé par l'abrasion. Ne pas exposer l'équipement directement à la lumière du soleil. Noter également ce qui suit :

- Étirer les bretelles, le ceinturon et les brides du serre-tête du masque facial.
- Pour le stockage, placer le masque dans un sac de protection (contacter Dräger pour obtenir un sac approprié).
- Guider les tuyaux en caoutchouc de telle manière que le rayon de courbure ne soit pas trop prononcé et que le tuyau ne soit pas étiré, comprimé ou tordu.
- Fixer soigneusement l'appareil respiratoire à un point de fixation en hauteur afin de l'empêcher de tomber.

7 Précautions et limitations NIOSH

I – Contient des composants électriques susceptibles de provoquer des incendies dans des atmosphères inflammables et explosives.

J – L'utilisation et l'entretien incorrects de ce produit peuvent entraîner des blessures ou la mort.

M – Tous les respirateurs homologués doivent être sélectionnés, équipés, utilisés et entretenus selon les standards MSHA, OSHA et autres réglementations en vigueur.

N – Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Toujours utiliser les bonnes pièces de rechange dans la configuration spécifiée par le fabricant.

O – Se reporter aux modes d'emploi et/ou aux manuels d'entretien pour obtenir des informations sur l'utilisation et la maintenance de ces respirateurs.

S – Des modes d'emploi spéciaux ou critiques et/ou des limitations d'utilisation spécifiques s'appliquent. Se référer aux modes d'emploi avant toute opération.

7.1 S – Modes d'emploi spéciaux ou critiques

Homologation pour un usage à des températures supérieures à -25 °F (-31,7 °C).

8 Mise au rebut

Le cas échéant, mettre le PAS® Colt au rebut selon les réglementations nationales et locales sur l'élimination des déchets.

9 Données techniques

- Raccord haute pression : jusqu'à 3000 psi, raccord au CGA 346.
- Soupape à la demande au raccord du masque facial : connecteur à encliqueter.
- Bouteille d'air comprimé : les bouteilles sont disponibles en aluminium ou en matériau composite (contacter Dräger pour plus d'informations). Les bouteilles fournies par Dräger sont complètement chargées.

10 Contact

Tout problème lié à l'équipement, comprenant les dommages, les dysfonctionnements ou les défaillances de l'appareil respiratoire susceptible de présenter un risque pour l'utilisateur doit être signalé au Service Clients Dräger aux États-Unis – Téléphone : Phone 1-800-437-2437.

Vous pouvez contacter l'organisme de certifications à : NIOSH, NPPTL – Téléphone – 1-412-386-4000