

Kullanım kılavuzu

## Infinity Acute Care System



### UYARI

Aksesuarları düzgün kullanmak için ilgili tüm kullanma kılavuzlarını okuyun ve verilen talimatlara uyun.

İzleme aksesuarları  
**SW VG4.n**

## Bu kullanım kılavuzu ile çalışma

---

### Ana bölümün

Üstbilgi satırındaki başlık, bilgileri bulma ve gezinme konusunda yardımcı olur.

### Kullanıcı için olan açıklamalar

İlgili aksesuarlara görsel ve metinsel bir genel bakışı sağlamak için metinler ve resimler yanında gerektiği yerde bunlara ait parça numaralarını da vermektedir.

## Yazım kuralları

---

- 1 Ardışık sayılar 1'den başlayan işlem adımlarını, her yeni işlemde "1" değerinde artarak göstermektedir.
- Koyu noktalar ayrı ayrı işlemleri veya farklı işlem seçeneklerini göstermektedir.
- Çizgiler verilerin, seçeneklerin ya da nesnelerin listesini gösterir.
- (A) Parantez içindeki harfler ilgili çizimdeki bileşenleri gösterir.
- A Çizimlerdeki harfler metinde belirtilen bileşenleri gösterir.

## Genel sürüm notları IACS

---

Asistol ve ventriküler fibrilasyon olayları haricinde başka hiçbir aritmi olayı, yazılım sürümü VG1 donanımlı ICS trendlerinde belirmez.

### NOT

Profilleri içe ve dışa aktarmak için FAT32 bellek çubuğu kullanın. NTFS formatlı USB çubukları güvenilir sonuçlar meydana getirmez. (*Sistem konfigürasyonu bölümü*)

Cockpit, bir Citrix işlemci XenApp sunucusu kullanan BT uygulamalarını destekler (ICA istemci sürümü 12.3.0.8). (*BT uygulamaları bölümü*)

Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm cihazlar ve aksesuarlar her ülkede satış için onaylanmamış olabilir. Lütfen yerel Dräger servis temsilcinize danışın.

## Ticari Markalar

---

- Infinity®
- Acute Care System™
- Hemo4®
- Hemo2®
- MPod®
- MCable™
- MonoLead®

Dräger'in ticari markalarıdır.

- rainbow®
  - Masimo®
  - Masimo® SET® (Sinyal Çıkarma Teknolojisi)
- Masimo Corporation'un tescilli ticari markalarıdır.
- Nellcor™
  - OxiMax™
  - OxiBand™
  - Durasensor™
- Nellcor Puritan Bennett, LLC.'in ticari markalarıdır.

## Tanımlar

---

### **UYARI**

Bir UYARI ifadesi, uyulmadığı takdirde ölümler veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli durumlar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

### **DİKKAT**

İKAZ ifadesi, kaçınılmaması halinde kullanıcının ya da hastanın hafif ya da orta şiddette yaralanmasıyla ya da ekipmanın ya da diğer bir mülkün zarar görmesiyle sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli durumlara ilişkin önemli bilgiler sunar.

### **NOT**

NOT ifadesi, işletim sırasında meydana gelebilecek güçlüklerden kaçınmak üzere ek bilgiler sunar.

# İçindekiler

---

Bu kullanım kılavuzu ile çalışma . . . . .	2
Yazım kuralları . . . . .	2
Genel sürüm notları IACS. . . . .	3
<b>Hasta ve kullanıcı güvenliği için . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Aksesuar listesi . . . . .</b>	<b>11</b>
Infinity Acute Care sistem aksesuarlarına genel bakış . . . . .	13
Genel IACS aksesuarları . . . . .	16
IACS / M540 seçenekler. . . . .	18
EKG izleme – yeniden kullanılabilir lead setleri . . . . .	19
EKG izleme – tek hastada kullanılabilir lead setleri . . . . .	21
EKG izleme – MonoLead . . . . .	23
EKG izleme - yenidoğan. . . . .	25
Hemo2 pod veya Hemo4 pod ile invazif kan basıncı (IBP). . . . .	26
MPod ile IBP İzleme – QuadHemo veya MCable – Dual Hemo . . . . .	27
İnvazif olmayan kan basıncı (NIBP) izleme – Dräger konektörler . . . . .	28
İnvaziv olmayan kan basıncı (NIBP) izleme - yenidoğan. . . . .	30
Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (rainbow sensörleri) . . . . .	31
Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (M-LNCS) . . . . .	33
Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (LNCS) . . . . .	36
Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (LNCS) . . . . .	38
Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (M-LNCS). . . . .	40
Masimo SpO2 aksesuarları. . . . .	42
Nabız oksimetrisi izleme – Nellcor OxiMax . . .	43
Kardiyak (C.O.) çıkış izleme. . . . .	45
CO2 monitörizasyonu . . . . .	46
Sıcaklık izleme . . . . .	47
MCable – Analog/Senk. . . . .	50

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır.

## Hasta ve kullanıcı güvenliği için

---

Bu kullanma kılavuzundaki talimatlara sıkı bir şekilde uyun . . . . .	8
Genel önlem . . . . .	8
Eğitim . . . . .	8
Steril aksesuarlar . . . . .	8
Aksesuarların kullanılabilirliği . . . . .	8
Bağlı cihazlar . . . . .	9
Aksesuarların montajı . . . . .	9

## Bu kullanma kılavuzundaki talimatlara sıkı bir şekilde uyun

### UYARI

**Hasta güvenliğini korumak için Infinity Acute Care System (IACS) uygulamalarına yönelik Kullanım kılavuzunda bulunan veya ekipman etiketlerinde belirtilen tüm UYARI ve İKAZ ibarelerine uyun.**

### DİKKAT

Cihazı temizlemeden *önce* tüm temizleme talimatlarını (örneğin dezenfektan üreticisinin talimatlarını veya hastane talimatlarını) dikkatle okuyun. Cihaza özel temizlik talimatları için Infinity Acute Care System M540 Kullanım kılavuzundaki "Temizleme" başlıklı bölüme bakın.

## Genel önlem

### DİKKAT

Bir aksesuar tekrar kullanılabilir olsa bile, sınırlı bir hizmet ömrüne sahiptir. Kullanma ve yeniden işleme, yıpranmayı artırabilir ve hizmet ömrünü belirgin bir şekilde kısaltabilir (örn. dezenfektan artıkları, otoklav sırasında malzemeye daha yoğun olarak saldırabilir). Çatlak, deformasyon, renk değişimi, soyulma gibi yıpranma belirtileri görünür durumdaysa, ilgili aksesuarlar değiştirilmelidir.

## Eğitim

Kullanıcılara yönelik eğitim, Dräger kuruluşu sorumlusundan alınabilir (bkz. [www.draeger.com](http://www.draeger.com)).

## Steril aksesuarlar

### DİKKAT

Tıbbi cihaz arızası ve/veya hastanın zarar görmesi riski.

Steril olarak ambalajlanmış aksesuarları, ambalajı açılmışsa, hasar görmüşse veya steril olmadığına dair başka bir belirtinin bulunması durumunda kullanmayın. Tek kullanımlık cihazlar ve aksesuarlar ikinci kez kullanılmamalı, işlenmemeli veya sterilize edilmemelidir.

## Aksesuarların kullanılabilirliği

Bazı ürünler, tüm ülkeler tarafından onaylanmış olmadığı için dünya genelinde kullanıma sunulmamaktadır.

İstenildiğinde, teknik dokümantasyon sağlanabilir.

### UYARI

**Uyumlu olmayan aksesuarlara bağlı risk**

**Dräger yalnızca, geçerli aksesuarlar listesinde belirtilen aksesuarların uyumluluğunu test etmiştir. Uyumlu olmayan diğer aksesuarların kullanılması durumunda, tıbbi cihaz arızasına bağlı hasta yaralanması riski bulunmaktadır.**

**Dräger, bu tıbbi cihazın yalnızca geçerli aksesuarlar listesinde belirtilen aksesuarlar ile birlikte kullanılmasını önerir.**



## Baęlı cihazlar

### UYARI

#### Elektrik çarpması ve cihazın arızalanma riski

Bu kullanma kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olmayan baęlı herhangi bir cihaz veya cihaz kombinasyonu, tıbbi cihazın işlevini gerektięi şekilde yerine getirememesine ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu tıbbi cihazı çalıştırmadan önce, baęlanan tüm cihazların veya cihaz kombinasyonlarının kullanma kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyun.

## Aksesuarların montajı

### DİKKAT

Cihaz arızalanma riski

Ana cihaza takacaęınız aksesuarları, ana cihazın kullanma kılavuzuna uygun olarak kurun. Ana cihaz ile güvenli bir baęlantı kurulduğundan emin olun.

Kullanım kılavuzuna sıkı sıkıya uyun!

### DİKKAT

Yanlış kullanım riski

Bu aksesuarlar tek tek satılmaz. Toplu pakette kullanma kılavuzunun yalnızca tek bir kopyası bulunur ve bu nedenle kullanıcıların kolay erişebileceęi bir yerde saklanmalıdır.

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır.


## Aksesuar listesi







































<b>Infinity Acute Care sistem aksesuarlarına genel bakış</b> . . . . .	13	Yeniden kullanılabilir yetişkin/çocuk NIBP manşetler. . . . .	28
<b>Genel IACS aksesuarları</b> . . . . .	16	Tek hastada kullanılabilen yetişkin/çocuk NIBP manşetler. . . . .	29
Sistem bileşenleri . . . . .	16	<b>İnvaziv olmayan kan basıncı (NIBP) izleme - yenidoğan</b> . . . . .	30
Kablolarda ve fare . . . . .	16	NIBP hortumu . . . . .	30
Klavyeler. . . . .	16	Tek hastada kullanılabilen yenidoğan NIBP manşetler. . . . .	30
Cihaz arabirim kitleri. . . . .	17	<b>Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (rainbow sensörleri)</b> . . . . .	31
Uzun tavan kurulum kabloları . . . . .	17	Masimo rainbow SET MCable . . . . .	31
Çeşitli donanım. . . . .	18	Masimo rainbow SET ara kablolar . . . . .	31
İş istasyonu montajları . . . . .	18	Masimo rainbow SET ReSposable sensörler . . . . .	32
Güç kaynağı montajı. . . . .	18	Masimo rainbow SET tek hasta kullanımlı sensörleri. . . . .	32
Cockpit ve M500/M540 için montaj düzenekleri. . . . .	18	Masimo rainbow SET yeniden kullanılabilir sensörler . . . . .	32
<b>IACS / M540 seçenekler</b> . . . . .	18	<b>Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (M-LNCS)</b> . . . . .	33
<b>EKG izleme – yeniden kullanılabilir lead setleri</b> . . . . .	19	Masimo rainbow SET MCable . . . . .	33
<b>EKG izleme – tek hastada kullanılabilir lead setleri</b> . . . . .	21	Masimo rainbow SET ara kablolar . . . . .	33
<b>EKG izleme – MonoLead</b> . . . . .	23	Masimo yeniden kullanılabilen M-LNCS sensörler . . . . .	34
EKG aksesuarları . . . . .	23	Masimo tek hasta kullanımı M-LNCS sensörleri. . . . .	34
MonoLead başlıkları . . . . .	24	Masimo tek hasta kullanımlık M-LNCS travma sensörleri. . . . .	35
<b>EKG izleme - yenidoğan</b> . . . . .	25	<b>Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (LNCS)</b> . . . . .	36
Yenidoğan lead setleri ve aksesuarlar . . . . .	25	Masimo rainbow SET MCable . . . . .	36
<b>Hemo2 pod veya Hemo4 pod ile invazif kan basıncı (IBP)</b> . . . . .	26	Masimo rainbow SET LNCS ara kabloları . . . . .	36
IBP podları ve kabloları . . . . .	26	Masimo tek hasta kullanımlık LNCS sensörler . . . . .	37
Transdüser adaptör kabloları . . . . .	26	Masimo yeniden kullanılabilen LNCS sensörler . . . . .	37
<b>MPod ile IBP izleme – QuadHemo veya MCable – Dual Hemo</b> . . . . .	27	Masimo tek hasta kullanımlık LNCS travma sensörleri. . . . .	37
IBP kabloları . . . . .	27		
Transdüser adaptör kabloları . . . . .	27		
<b>İnvazif olmayan kan basıncı (NIBP) izleme – Dräger konektörler</b> . . . . .	28		
NIBP hortumu . . . . .	28		

<b>Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (LNCS)</b> . . . . .	38
Masimo SET LNCS ara kabloları . . . . .	38
Masimo tek hasta kullanımlık LNCS sensörler . . . . .	38
Masimo yeniden kullanılabilen LNCS sensörler. . . . .	39
Masimo tek hasta kullanımlık LNCS travma sensörleri . . . . .	39
<b>Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (M–LNCS)</b> . . . . .	40
Masimo SET M–LNCS ara kabloları . . . . .	40
Masimo tek hasta kullanımı M–LNCS sensörleri . . . . .	41
Masimo yeniden kullanılabilen M–LNCS sensörler. . . . .	41
Masimo tek hasta kullanımlık M–LNCS travma sensörleri . . . . .	42
<b>Masimo SpO2 aksesuarları</b> . . . . .	42
<b>Nabız oksimetrisi izleme – Nellcor OxiMax</b> . . . . .	43
Nellcor SpO2 kabloları . . . . .	43
Nellcor tek hastada kullanılabilen sensörler . . . . .	43
Nellcor yeniden kullanılabilir sensör . . . . .	44
<b>Kardiyak (C.O.) çıkış izleme</b> . . . . .	45
C.O. kablolar, kateterler ve termistörler . . . . .	45
Kardiyak çıkış kitleri (gösterilmemiştir) . . . . .	45
<b>CO2 monitörizasyonu.</b> . . . . .	46
CO2 kabloları . . . . .	46
Tek kullanımlık havayolu adaptörleri . . . . .	46
Yeniden kullanılabilir havayolu adaptörleri . . . . .	46
Ek aksesuarlar (gösterilmemiştir) . . . . .	46
<b>Sıcaklık izleme</b> . . . . .	47
Sıcaklık kabloları . . . . .	47
Cilt problemleri . . . . .	47
Sıcaklık kabloları . . . . .	48
Genel amaçlı problemler . . . . .	48
<b>MCable – Analog/Senk.</b> . . . . .	50
Analog/senk kabloları . . . . .	50

## Infinity Acute Care sistem aksesuarlarına genel bakış

Aşağıdaki şema, Infinity Acute Care System ile kullanılabilen aksesuarlara genel bakış sağlamaktadır.



CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> & Analog/Senkron	Analog ve Senkron	Sıcaklık		
 <p style="text-align: center;">+</p>  <p>Pediyatrik</p>  <p>Yetişkin</p>	 <p style="text-align: center;">+   +</p>  <p>CO<sub>2</sub></p>  <p>Analog/ Senkron</p>	 <p style="text-align: center;">+   +</p> 	  <p style="text-align: center;">+   +</p>   <p style="text-align: center;">+</p>     <p style="text-align: center;">+</p>		
EKG – yeniden kullanılabilir	EKG – MonoLead	EKG – tek kullanımlık	EKG – Neo	NIBP	
				<p>Yetişkin/Çocuk    Yenidoğan</p>  	
			<p style="text-align: center;">+</p> 	<p style="text-align: center;">+</p>	
				 	
				 	

Bu bölümde Infinity Acute Care System (IACS) ile kullanılabilen aksesuarların listesi verilmiştir.

Bölüm aşağıdaki kısımlara ayrılmıştır:

- "Genel IACS aksesuarları" sayfa 16
- "IACS / M540 seçenekler" sayfa 18
- "EKG izleme – yeniden kullanılabilir lead setleri" sayfa 19
- "EKG izleme – tek hastada kullanılabilir lead setleri" sayfa 21
- "EKG izleme – MonoLead" sayfa 23
- "EKG izleme - yenidoğan" sayfa 25
- "Hemo2 pod veya Hemo4 pod ile invazif kan basıncı (IBP)" sayfa 26
- "MPod ile IBP İzleme – QuadHemo veya MCable – Dual Hemo" sayfa 27
- "İnvazif olmayan kan basıncı (NIBP) izleme – Dräger konektörler" sayfa 28
- "İnvaziv olmayan kan basıncı (NIBP) izleme - yenidoğan" sayfa 30
- "Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (rainbow sensörleri)" sayfa 31
- "Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (LNCS)" sayfa 33
- "Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (LNCS)" sayfa 36
- "Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (LNCS)" sayfa 38
- "Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (M-LNCS)" sayfa 40
- "Nabız oksimetrisi izleme – Nellcor OxiMax" sayfa 43
- "Kardiyak (C.O.) çıkış izleme" sayfa 45
- "CO2 monitörizasyonu" sayfa 46
- "Sıcaklık izleme" sayfa 47
- "MCable – Analog/Senk" sayfa 50

Aşağıdaki sayfalarda, her bir parametre bölümü, aksesuar adlarını ve parça numaralarını gösteren bir veya daha fazla tablo ile birlikte parametreye özgü aksesuarları belirten bir şema içerir. Şemalarda gösterilen harfler tablolardaki harflere denk düşer. Bazı aksesuarlar şemada listelenemeyecek kadar çok sayıda olduğu için bunlara bir harf verilmemiştir.

Parça numaraları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel parça numaralarını öğrenmek için Dräger temsilcinizi arayın.

Dräger onaylı aksesuarların kullanılmaması durumunda IACS düzgün çalışmayabilir.

## Genel IACS aksesuarları

Aşağıdaki tabloda IACS için sistem bileşenleri, güç kabloları, sistem kabloları ve klavyeler listelenmektedir.

### Sistem bileşenleri

Aşağıdaki parçalar IACS sisteminin bileşenleridir. Bunlar ayrı satın alınamaz. Ek bilgi için Dräger temsilcinizi arayın.

Parça	Parça No.
Infinity M500	MS20407
Infinity M540	MS20401
Infinity P2500	MS22277
Infinity PS50	8416800
Masaüstü için 120W güç kaynağı (PS120)	2606270
PS120 için IACS Y-adaptörü	MS29702

### Klavyeler

Parça	Parça No.
Standart klavye (Rusça)	MS24520
Yıkanabilir klavye (Çekçe)	MS22286
Yıkanabilir klavye (Danca)	MS20790
Yıkanabilir klavye (İngilizce)	MS22288
Yıkanabilir klavye (Fransızca)	MS22295
Yıkanabilir klavye (Almanca)	MS22287
Yıkanabilir klavye (Yunanca)	MS23692
Yıkanabilir klavye (Macarca)	MS22282
Yıkanabilir klavye (İtalyanca)	MS22283
Yıkanabilir klavye (Norveççe)	MS22284
Yıkanabilir klavye (Portekizce)	MS22291
Yıkanabilir klavye (İspanyolca)	MS22294
Yıkanabilir klavye (İsveççe/Fince)	MS22285
Yıkanabilir klavye (Türkçe)	MS22292

### Kablolar ve fare

Parça	Parça No.
Fare	MS23352
Fare pedi	MS24519
Sistem kablosu, 1,5 m (4,9 ft)	MS20135
Sistem kablosu, 2,5 m (8,2 ft)	MK08707
Sistem kablosu, 3,5 m (11,5 ft)	MK08708
Sistem kablosu, 4,5 m (14,7 ft)	MS20614
PS50 için IACS Y-kablosu	MS20345
Sistem kablosu, 2,2 m (7,2 ft) ( <i>Not Bu kablo sadece Zeus IE birlikte kullanılabilir</i> )	MK04408
Ethernet kablosu, 4,9 m (16,1 ft)	4726399
Ethernet kabloları, 2,4 m (7,9 ft)	4726381
Ethernet kabloları, 1,2 m (3,9 ft)	4726373
Hemşire çağırma kablosu	8417370
Dışa aktarma protokolü kablosu	MS22948



**Cihaz arabirim kitleri**

Infinity Acute Care System için aşağıdaki aksesuarlar kullanılabilir.

Parça	Parça No.
<p>Cihaz bağlantı kablosu, 3 m (9,8 ft) – IACS'yi aşağıda belirtilen ventilatörlere bağlar:</p> <p><b>Edwards SvO<sub>2</sub>/CCO cihazları:</b>            Vigilance II            Vigileo            EV1000</p> <p><b>Dräger ventilatörler:</b>            V500            V300            VN500            Evita 2D            Evita 4            EvitaXL            Oxylog 3000+            Carina            Savina 300</p> <p><b>Maquet ventilatör:</b>            Servo-i</p> <p><b>BIS cihazı</b>            BIS Vista</p> <p><b>NMT cihazları</b>            Tof Scan            Tof Watch SX</p>	MS25836

Parça	Parça No.
<p>Cihaz bağlantı kablosu, 5 m (16,4 ft) – IACS'yi aşağıda belirtilen ventilatörlere bağlar:</p> <p><b>Edwards SvO<sub>2</sub>/CCO cihazları:</b>            Vigilance II            Vigileo            EV1000</p> <p><b>Dräger ventilatörler:</b>            V500            V300            VN500            Evita 2D            Evita 4            EvitaXL            Oxylog 3000+            Carina            Savina 300</p> <p><b>Maquet ventilatör:</b>            Servo-i</p>	MS25837
Primus, Primus IE, Apollo arayüz kiti	8608532
Perseus A500 ve Zeus IE arayüz kiti (Medibus kablosu gerektirir)  Medibus kablosu (arayüz kiti MK09027 için)	MK09027 ve MK09269

**Uzun tavan kurulum kabloları**

Parça	Parça No.
Evrensel set, 2 x 5 m (6,5 x 16,4 ft)	G26455
Evrensel set, 2 x 8 m (6,5 x 26,25 ft)	G26456
IACS elektrik panosu grubu	G26740
IACS tavan bağlantı seti	G25955

**Çeşitli donanım**

Parça	Parça No.
Nakil yerleştirme ve kelepçeleme	MS28144
Kablo kancası	MS26297
SpO2 MCable montajı	MS26266
Masimo rainbow SET MCable montajı	MS28576
M540 döner standı	RS-0025-05C

**Güç kaynağı montajı**

Parça	Parça No.
Duvar montajı adaptörü CPS/IDS güç kaynağı	4720061
CPS/IDS güç kaynağı için raylı montaj	4720095
Duvar braketi CPS/IDS güç kaynağı	4720129
Güç kaynağı makaralı dayanak braketi CPS/IDS	4720103
Masaüstü güç kaynağı için montaj braketi, 120 W	MS31216

**İş istasyonu montajları**

Parça	Parça No.
İş istasyonu montajı	MS17139
Montaj braketi rayı GCX	MS15934

**Cockpit ve M500/M540 için montaj düzenekleri**

Parça	Parça No.
Dräger kaldırma kolu, ön ray, VESA, +300	G96548
Dräger çift kol, ön ray, VESA	G96715

**NOT**

GCX'in tüm diğer donanımları yalnızca doğrudan GCX şirketinden veya dağıtıcılarından birinden satın alınabilir.


**IACS / M540 seçenekler**

Aşağıdaki tablo mevcut IACS seçeneklerini göstermektedir. Devam eden bazı promosyonlar sırasında mevcut olabilecek seçenekleri, yerel satış temsilciniz ile birlikte kontrol edin. M540 veya

C700/C500 üzerindeki menü seçenekleri ilgili seçenekler etkinleştirilmediği sürece kullanılamayacaktır.

Seçenek	M540 bağımsız	C700	C500	Parça No.
M540 kablosuz	Evet	Hayır	Hayır	MS16266
Tam aritmi	Evet	Evet	Evet	MS22225
Multi IBP	Evet	Evet	Evet	MS20504
12 başlıklı EKG	Evet	Evet	Evet	MS20508
12 kanal	Hayır	Hayır	Evet	MS20505
16 kanal	Hayır	Evet	Evet	MS20506
Web erişimli düzenler	Hayır	Evet	Evet	MS20511
Web erişimli sekmeler	Hayır	Evet	Evet	MS20512
Görünüm düzenleyici	Hayır	Evet	Evet	MS20515
Fizyolojik hesaplamalar	Hayır	Evet	Evet	MS20516

## EKG izleme – yeniden kullanılabilir lead setleri

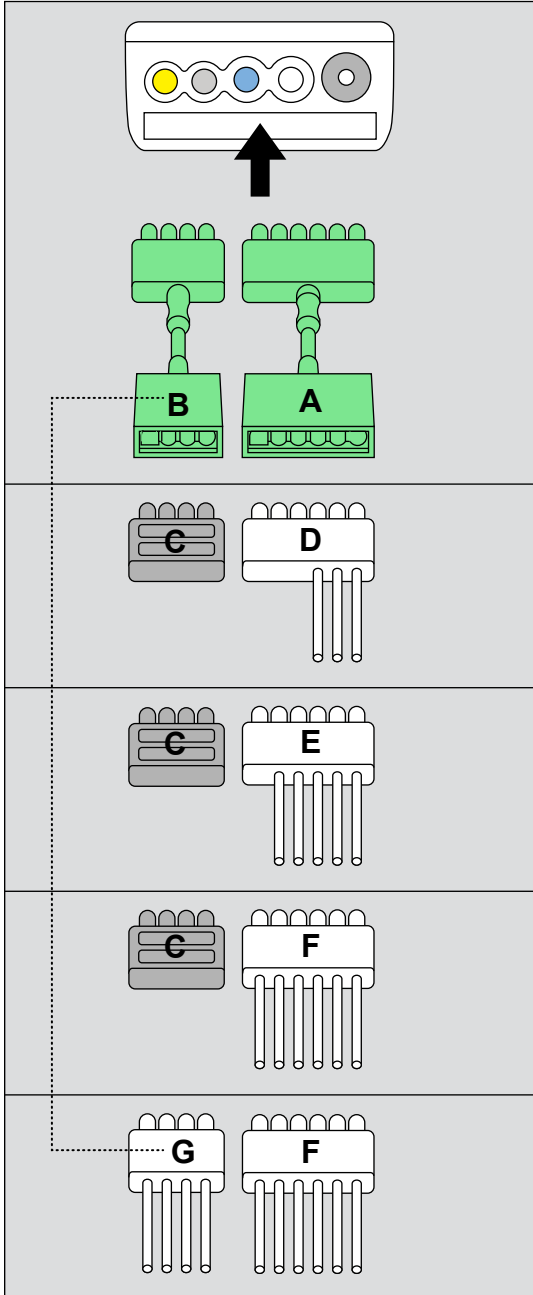

### EKG aksesuarları

	Parça	Parça No.
A	EKG uzatma kablosu 3/5/6, 2 m (6,5 ft) <sup>1)</sup>	MS16256
B	EKG uzatma kablosu, 4 başlıklı, 2 m (6,5 ft)	MS31435
C	EKG 4 başlıklı aralayıcı, 10 adet	MS22832

#### NOT

<sup>1)</sup> Uzatma kablosu (MS16256) bazı MonoLead başlıkları, klasik başlıklar ve tek hastada kullanılabilen başlıklar ile çalışır. Uzatma kablosu, EKG 4 başlıklı tutucu setleriyle uyumlu değildir.


#### UYARI

**Elektrocerrahi sırasında yanık tehlikesini azaltmak için, 4 başlıklı uzatma kablolarının elektrocerrahi ortamlarda kullanılmaması desteklenmemektedir.**

### Geleneksel yeniden kullanılabilir başlık takımları

	Parça	Parça No.	Eski Parça No.
<b>D</b>	EKG tutacağı, 3 başlıklı, IEC1 (Avrupa), 1 m (3,3 ft)	MP03401	MS16159
	EKG tutucu 3-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m (3,3 ft)	MP03402	MS16231
<b>E</b>	EKG tutacağı, 5 başlıklı, IEC1 (Avrupa), 1 m (3,3 ft)	MP03403	MS16158
	EKG tutucu 5-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m (3,3 ft)	MP03404	MS16546
<b>F</b>	EKG tutacağı, 6 başlıklı, IEC1 (Avrupa), 1 m (3,3 ft)	MP03405	MS16157
	EKG tutucu 6-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m (3,3 ft)	MP03406	MS16547
<b>G</b>	EKG tutacağı, 4 başlıklı, IEC1 (Avrupa), 1 m (3,3 ft)	MP03407	MS22365
	EKG tutucu 4-başlık, IEC2 (AHA/US) 1 m (3,3 ft)	MP03408	MS22364

## EKG izleme – tek hastada kullanılabilir lead setleri



### EKG aksesuarları

	Parça	Parça No.
A	EKG uzatma kablosu 3/5/6, 2 m (6,5 ft) <sup>1)</sup>	MS16256
B	EKG uzatma kablosu, 4 başlıklı, 2 m (6,5 ft)	MS31435
C	EKG 4 başlıklı aralayıcı, 10 adet	MS22832

#### NOT

<sup>1)</sup> Uzatma kablosu (MS16256) bazı MonoLead başlıkları, klasik başlıklar ve tek hastada kullanılabilen başlıklar ile çalışır. Uzatma kablosu, EKG 4 başlıklı tutucu setleriyle uyumlu değildir.


#### UYARI

Elektrocerrahi sırasında yanık tehlikesini azaltmak için, 4 başlıklı uzatma kablolarının elektrocerrahi ortamlarda kullanılmaması desteklenmemektedir.

### Tek hasta kullanımlı başlık setleri

	Parça	Parça No.
<b>D</b>	EKG tutucu 3-başlık, IEC1 (Avrupa), 1 m (3,3 ft)	MP00875
	EKG tutucu 3-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m (3,3 ft)	MP00877
<b>E</b>	EKG tutucu 5-başlık, IEC1 (Avrupa), 1 m / 1,5 m (3,3 ft / 4,9 ft)	MP00879
	EKG tutucu 5-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m / 1,5 m (3,3 ft / 4,9 ft)	MP00881
<b>F</b>	EKG tutucu 6-başlık, IEC1 (Avrupa), 1 m / 1,5 m (3,3 ft / 4,9 ft)	MP03122
	EKG tutucu 6-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m / 1,5 m (3,3 ft / 4,9 ft)	MP03123
<b>G</b>	EKG tutucu 4-başlık, IEC1 (Avrupa), 1 m (3,3 ft)	MP03120
	EKG tutucu 4-başlık, IEC2 (AHA/US), 1 m (3,3 ft)	MP03121

## EKG izleme – MonoLead



### EKG aksesuarları

	Parça	Parça No.
A	EKG uzatma kablosu 3/5/6, 2 m (6,5 ft) <sup>1)</sup>	MS16256
B	EKG uzatma kablosu, 4 başlıklı, 2 m (6,5 ft) <sup>2)</sup>	MS31435
C	EKG 4 başlıklı aralayıcı, 10 adet	MS22832

#### NOT

<sup>1)</sup> Uzatma kablosu (MS16256) bazı MonoLead başlıkları, klasik başlıklar ve tek hastada kullanılabilen başlıklar ile çalışır. Uzatma kablosu, EKG 4 başlıklı tutucu setleriyle uyumlu değildir.

<sup>2)</sup> 4 başlıklı uzatma kablosu MS31435, 3,7 m (12,1 ft) uzunluğundaki MS20475 ve MS20476 MonoLead başlıkları ile kullanılamaz.

#### UYARI

**Elektrocerrahi sırasında yanık tehlikesini azaltmak için, 4 başlıklı uzatma kablolarının elektrocerrahi ortamlarda kullanılmaması desteklenmemektedir.**

**MonoLead başlıkları**

	Parça	Parça No.
<b>D</b>	EKG MonoLead 3 başlık, IEC1 (Avrupa), 2 m (6,5 ft)	MS14555
	EKG MonoLead 3 başlık, IEC2 (AHA/US), 2 m (6,5 ft)	MS14556
	EKG MonoLead 3 başlık, IEC1 (Avrupa), 4,1 m (13,5 ft) <sup>1)</sup>	MS28561
	EKG MonoLead 3 başlık, IEC2 (AHA/US), 4,1 m (13,5 ft) <sup>1)</sup>	MS28557
<b>E</b>	EKG MonoLead 5 başlık, IEC1 (Avrupa), 2,5 m (8,2 ft)	MS14559
	EKG MonoLead 5 başlık, IEC2 (AHA/US) 2,5 m (8,2 ft)	MS14560
	EKG MonoLead 5 başlık, IEC1 (Avrupa), 5,3 m (17,4 ft) <sup>1)</sup>	MS28559
	EKG MonoLead 5 başlık, IEC2 (AHA/US), 5,3 m (17,4 ft) <sup>1)</sup>	MS28558
<b>F</b>	EKG MonoLead 6 başlık, IEC1 (Avrupa), 3 m (10 ft)	MS14683
	EKG MonoLead 6 başlık, IEC2 (AHA/US), 3 m (10 ft)	MS14682
	EKG MonoLead 6 başlık, IEC1 (Avrupa), 5,7 m (18,7 ft) <sup>1)</sup>	MS17185
	EKG MonoLead 6 başlık, IEC2 (AHA/US), 5,7 m (18,7 ft) <sup>1)</sup>	MS28560
<b>G</b>	EKG MonoLead 4 başlık, IEC1 (Avrupa), 1,7 m (5,6 ft)	MS14693
	EKG MonoLead 4 başlık, IEC2 (AHA/US), 1,7 m (5,6 ft)	MS14694
	EKG MonoLead 4 başlık, IEC1 (Avrupa), 3,7 m (12,1 ft) <sup>2)</sup>	MS20476
	EKG MonoLead 4 başlık, IEC2 (AHA/US), 3,7 m (12,1 ft) <sup>2)</sup>	MS20475


**NOT**

<sup>1)</sup>Belirtilen aksesuarlar uzatma kablosu MS16256 ile birlikte **KULLANILAMAZ**

<sup>2)</sup>Belirtilen aksesuarlar uzatma kablosu MS31435 ile birlikte **KULLANILAMAZ**



## EKG izleme - yenidoğan




### Yenidoğan lead setleri ve aksesuarlar

#### UYARI

Elektrocerrahi (ESU) sırasında yanıkları önlemek için EKG yenidoğan 3 başlıklı adaptör kablosunu EKG uzatma kablosuyla (MS16256) birlikte kullanmayın.

	Parça	Parça No.
A	EKG yenidoğan 3 başlıklı adaptör kablosu, 2 m (6,5ft), tek pimli	MS25951
B	EKG elektrotu KittyKat 300 adet	5195024
C	EKG 4 başlıklı aralayıcı, 10 adet	MS22832

## Hemo2 pod veya Hemo4 pod ile invazif kan basıncı (IBP)



### IBP podları ve kabloları

Parça	Parça No.	
A	M540 Hemo Connect kablosu, 1,5 m (4,9 ft) <sup>1)</sup>	MS23897
	M540 Hemo Connect kablosu, 2,9 m (9,5 ft) <sup>1)</sup>	MS23898
B	Hemo2 pod ( <i>gösterilmiyor</i> – artık kullanılmıyor)	4319435
	Hemo4 pod (artık kullanılmıyor)	4315961


### NOT

<sup>1)</sup> 540 Hemo Connect kablosu Hemo2 pod/ Hemo4 pod ile birlikte kullanılır.

### Transdüser adaptör kabloları

Parça	Parça No.	
C	Hemo pod adaptörü, 10 pim	3375958
D	Hemo pod adaptörü, SensoNor, 7-pimli	MS23598
E	Hemo pod adaptörü, Baxter-Edwards	5196980
F	Hemo pod adaptörü, Abbott-Medex (Transtar)	5196998
G	Hemo pod adaptörü, Argon/BD	3375941

## MPod ile IBP İzleme – QuadHemo veya MCable – Dual Hemo



### IBP kabloları

	Parça	Parça No.
A	MCable – Dual Hemo	MS20783
B	M540 - Hemo Connect kablosu, 1,5 m (4,9 ft) <sup>1)</sup>	MS23897
	M540 Hemo Connect kablosu, 2,9 m (9,5 ft) <sup>1)</sup>	MS23898
C	MPod - QuadHemo	MS20725


### NOT

<sup>1)</sup> M540 Hemo Connect kablosu, MPod – QuadHemo ile birlikte kullanılır (MCable – Dual Hemo için gerekli değildir).

### Transdüser adaptör kabloları

	Parça	Parça No.
D	Abbott-Medex (Transtar)	MS22535
E	Baxter-Edwards	MS22147
F	Argon/BD	MS22148
G	Utah Medical	MS22534
H	Dräger 7-pimli	MS22533
I	Dräger 10-pimli	MS22532

## İnvazif olmayan kan basıncı (NIBP) izleme – Dräger konektörler



### NIBP hortumu

Aşağıdaki tek hastada kullanılabilen ve yeniden kullanılabilir manşetler ve hortumlar Dräger konektörler kullanır.

	Parça	Parça No.
A	Bağlantı tüpü, yetişkin/ çocuk 3,7 m (12,1 ft)	MP00953


### Yeniden kullanılabilir yetişkin/çocuk NIBP manşetler

#### NOT

Manşetlerin hiçbiri lateks içermez.


	Parça	Parça No.
B	Bebek kol manşeti, XXS 8 ile 13 cm arasında (3 ile 5 inç arasında)	MP00911
	Çocuk kol manşeti, XS 12 ile 19 cm arasında (5 ile 7 inç arasında)	MP00912
	Küçük yetişkin kol manşeti, S 17 ile 29 cm arasında (6 ile 10 inç arasında)	MP00913
	Yetişkin kol manşeti, M 23 ile 33 cm arasında (9 ile 13 inç arasında)	MP00915
	Yetişkin kol manşeti, M+ 23 ile 43 cm arasında (9 ile 17 inç arasında)	MP00916
	Yetişkin kol manşeti, M++ 23 ile 53 cm arasında (9 ile 21 inç arasında)	MP00917
	Büyük yetişkin kol manşeti, L 31 ile 40 cm arasında (12 ile 16 inç arasında)	MP00918
	Büyük yetişkin kol manşeti, L+ 31 ile 55 cm arasında (12 ile 22 inç arasında)	MP00919
	Büyük yetişkin bacak manşeti, XL 38 ile 50 cm arasında (15 ile 20 inç arasında)	MP00921

## Tek hastada kullanılabilen yetişkin/ çocuk NIBP manşetler



	Parça	Parça No.
<b>B</b>	Bebek kol manşeti, XXS, 8 ile 13 cm arasında (3 ile 5 inç arasında) 10 adet	MP00924
	Çocuk kol manşeti, XS, 12 ile 19 cm arasında (5 ile 7 inç arasında) 10 adet	MP00925
	Küçük yetişkin kol manşeti, S, 17 ile 29 cm arasında (6 ile 11 inç arasında) 10 adet	MP00926
	Yetişkin kol manşeti, M, 23 ile 33 cm arasında (9 ile 13 inç arasında) 10 adet	MP00928
	Yetişkin kol manşeti, M+, 23 ile 43 cm arasında (9 ile 17 inç arasında) 10 adet	MP00929
	Yetişkin kol manşeti, M++, 23 ile 53 cm arasında (9 ile 21 inç arasında) 10 adet	MP00930
	Yetişkin kol manşeti, L, 31 ile 40 cm arasında (12 ile 16 inç arasında) 10 adet	MP00931
	Yetişkin kol manşeti, L+, 31 ile 55 cm arasında (12 ile 22 inç arasında) 10 adet	MP00932
	Yetişkin kalça manşeti, XL, 38 ile 50 cm arasında (15 ile 20 inç arasında) 10 adet	MP00934

## İnvaziv olmayan kan basıncı (NIBP) izleme - yenidoğan



### NIBP hortumu

Aşağıdaki tek hastada kullanılabilen ve yeniden kullanılabilir manşetler ve hortumlar, üniversal konnektörleri kullanır.

	Parça	Parça No.
<b>A</b>	Yenidoğan NIBP hortumu, 2,4 m (7,87 ft)	2870298

### Tek hastada kullanılabilen yenidoğan NIBP manşetler

	Parça (kol çevresi)	Parça No.
<b>B</b>	Yenidoğan manşonu No. 1 3,1 ile 5,7 cm arasında (1,2 ile 2,2 inç arasında)	2870181
	Yenidoğan manşonu No. 2 4,3 ile 8,0 cm arasında (1,7 ile 3,1 inç arasında)	2870199
	Yenidoğan manşonu No. 3 5,8 ile 10,9 cm arasında (2,3 ile 4,3 inç arasında)	2870207
	Yenidoğan manşonu No. 4 7,1 ile 13,1 cm arasında (2,8 ile 5,1 inç arasında)	2870215
	Yenidoğan manşonu No. 5 8,3 ile 15,0 cm arasında (3,2 ile 6 inç arasında)	2870173



## Masimo rainbow SET ReSposable sensörler

Gerçekleştirdiği ölçümler SpHb, SpMet, SpO<sub>2</sub>, SpOC, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>C</b>	rainbow sensör, ReSposable R2-25a	MP02997	MP03058
	rainbow sensör, ReSposable R2-20a	MP02998	MP03059
<b>C &amp; D</b>	rainbow ReSposable sistem R2-25	MP03199	MP03060
	rainbow ReSposable sistem R2-20	MP03200	MP03061
	rainbow sensör, ReSposable R2-25 başlangıç paketi, yetişkin (1 yeniden kullanılabilir R2-25r sensörü artı 3 R2-25a tek kullanımlık yapışkan sensör içerir)	MP03131	MP03068
	rainbow sensör, ReSposable R2-20 başlangıç paketi, çocuk (1 yeniden kullanılabilir R2-20 sensörü artı 3 R2-20a tek kullanımlık yapışkan sensör içerir)	MP03132	MP03069
<b>D</b>	rainbow sensör, ReSposable R2-25r	MP03201	MP03062
	rainbow sensör, ReSposable R2-20r	MP03202	MP03063

### NOT

<sup>1)</sup> PVI sadece Masimo rainbow SET ile çalışır.

## Masimo rainbow SET tek hasta kullanımlı sensörleri

Gerçekleştirdiği ölçümler SpCO, SpMet, SpO<sub>2</sub>, SpOC, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>E</b>	rainbow sensör R25-L, 10 adet	MP02961	MP03054
	rainbow sensör R20-L, 10 adet	MP02962	MP03055
	rainbow sensörü R25, 10 adet	MP02959	MP03056
	rainbow sensörü R20, 10 adet	MP02960	MP03057
	rainbow yetişkin numune paketi (1 rainbow R25 and 1 rainbow R25-L)	MP02963	MP03066
	rainbow ped/inf numune paketi (1 rainbow R20 ve 1 rainbow R20-L)	MP02964	MP03067

### NOT

<sup>1)</sup> PVI sadece Masimo rainbow SET ile çalışır.

## Masimo rainbow SET yeniden kullanılabilir sensörler

Gerçekleştirdiği ölçümler SpCO, SpMet, SpO<sub>2</sub>, SpOC, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.


	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>F</b>	rainbow sensörü DCI, yetişkin	MP02971	MP03064
	rainbow sensörü DCIP, çocuk	MP02972	MP03065

### NOT

<sup>1)</sup> PVI sadece Masimo rainbow SET ile çalışır.



## Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (M-LNCS)



### Masimo rainbow SET MCable

	Parça	Parça No.
<b>A</b>	Infinity MCable – Masimo rainbow SET	MS27003

### Masimo rainbow SET ara kablolar

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>B</b>	rainbow cable RC-4, 1,2 m (4 ft)	MP02974	MP03052
	rainbow cable RC-12, 3,6 m (12 ft)	MP02975	MP03053

## Masimo yeniden kullanılabilen M–LNCS sensörler

Bu sensörlerin gerçekleştirdiği ölçümler SpO<sub>2</sub>, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>C</b>	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS DCI, yetişkin	MP02981	MP03080
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, DCIP, çocuk	MP02982	MP03081
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, TC-I kulak	MP02983	MP03082
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, TF-I, yetişkin	MP02985	MP03083
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, YI çoklu alan	MP02984	MP03084
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, DBI, yetişkin <sup>2)</sup>	MP03207	MP03085

### NOT

<sup>1)</sup> PVI sadece Masimo rainbow SET ile çalışır.

<sup>2)</sup> Masimo harekete ilişkin hiçbir iddiada bulunmaz.

## Masimo tek hasta kullanımı M–LNCS sensörleri

Bu sensörlerin gerçekleştirdiği ölçümler SpO<sub>2</sub>, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>D</b>	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Amtx-3, 20 adet	MP02976	MP03071
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Pmtx-3, 20 adet	MP02977	MP03072
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Inf-3, 20 adet	MP02978	MP03073
	SpO <sub>2</sub> , Neo-3, 20 adet	MP02979	MP03074
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, NeoPt-3, 20 adet	MP02980	MP03075
	Masimo M–LNCS, numune paketi	MP02986	MP03079

### NOT

<sup>1)</sup> PVI sadece Masimo rainbow SET ile çalışır.

**Masimo tek hasta kullanımlık M–LNCS travma sensörleri**

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>E</b>	Masimo M–LNCS travma sensörü, yetişkin	MP03206	MP03078
	Masimo M–LNCS travma sensörü, bebek/çocuk	MP03205	MP03077
	Masimo M–LNCS travma sensörü, yenidoğan	MP03204	MP03076

**DİKKAT**

Travma sensörler kullanıldığında, sensör kapalıyken tespit performansı bozulabilir.


## Nabız oksimetrisi izleme – Masimo rainbow SET (LNCS)

### Masimo rainbow SET MCable

	Parça	Parça No.
<b>A</b>	Infinity MCable – Masimo rainbow SET	MS27003

### Masimo rainbow SET LNCS ara kabloları

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>B</b>	SpO <sub>2</sub> Masimo kırmızı LNC-4 kablo, 1,2 m (4 ft)	MP02991	MP03030
	SpO <sub>2</sub> Masimo kırmızı LNC-10 kablo, 3 m (10 ft)	MP02992	MP03031
	SpO <sub>2</sub> Masimo kırmızı LNC-14 kablo, 4,3 m (14 ft)	MP03196	MP03032



484

### Masimo tek hasta kullanımlık LNCS sensörler

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>C</b>	Adtx, yetişkin, 20 adet	MP00790	MP03011
	Inf/Inf-3, bebek, 20 adet	MP00791	MP03013
	Neo/Neo-3, yenidoğan, 20 adet	MP00792	MP03014
	NeoPt/NeoPt-3, prematüre, 20 adet	MP00794	MP03015
	Pdtx, pediatrik, 20 adet	MP00793	MP03012

### Masimo yeniden kullanılabilen LNCS sensörler

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>D</b>	DCI yetişkin basamağı	MP00796	MP03019
	DCIP pediatrik basamağı	MP00795	MP03020
	TC-I yetişkin kulak	MP00788	MP03021
	YI yetişkin/ pediatrik/bebek/ yenidoğan çoklu alanı	MP00789	MP03023
	TF-I yetişkin alın	MP00799	MP03022
	Masimo LNCS-DBI, yetişkin <sup>1)</sup>	MP02993	MP03024

#### NOT

<sup>1)</sup> Masimo harekete ilişkin hiçbir iddiada bulunmaz.


### Masimo tek hasta kullanımlık LNCS travma sensörleri

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>E</b>	Masimo LNCS travma sensörü, yetişkin	MP03191	MP03016
	Masimo LNCS travma sensörü, yenidoğan	MP03192	MP03017
	Masimo LNCS travma sensörü, bebek/çocuk	MP03193	MP03018

#### DİKKAT

Travma sensörler kullanıldığında, sensör kapalıyken tespit performansı bozulabilir.

## Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (LNCS)



### Masimo SET MCable

	Parça	Parça No.
<b>A</b>	Infinity MCable – Masimo SET	MS20667

### Masimo SET LNCS ara kabloları

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>B</b>	Masimo ara kablo, LNCS 1,2 m (4 ft)	MP00800	MP03027
	Masimo ara kablo, LNCS 3 m (10 ft)	MP00797	MP03025
	Masimo ara kablo, LNCS 4,3 m (14 ft)	MP03194	MP03026

### Masimo tek hasta kullanımlık LNCS sensörler

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>C</b>	Adtx, yetişkin, 20 adet	MP00790	MP03011
	Inf/Inf-3, bebek, 20 adet	MP00791	MP03013
	Neo/Neo-3, yenidoğan, 20 adet	MP00792	MP03014
	NeoPt/NeoPt-3, prematüre, 20 adet	MP00794	MP03015
	Pdtx, pediatrik, 20 adet	MP00793	MP03012

078

### Masimo yeniden kullanılabilen LNCS sensörler

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>D</b>	DCI yetişkin basamağı	MP00796	MP03019
	DCIP pediatrik basamağı	MP00795	MP03020
	TC-I yetişkin kulak	MP00788	MP03021
	YI yetişkin/çocuk bebek/yenidoğan çoklu site	MP00789	MP03023
	TF-I yetişkin alın	MP00799	MP03022
	Masimo LNCS-DBI, yetişkin <sup>1)</sup>	MP02993	MP03024

#### NOT

<sup>1)</sup> Masimo harekete ilişkin hiçbir iddiada bulunmaz.

### Masimo tek hasta kullanımlık LNCS travma sensörleri

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>E</b>	Masimo LNCS travma sensörü, yetişkin	MP03191	MP03016
	Masimo LNCS travma sensörü, yenidoğan	MP03192	MP03017
	Masimo LNCS travma sensörü, bebek/çocuk	MP03193	MP03018

#### DİKKAT

Travma sensörler kullanıldığında, sensör kapalıyken tespit performansı bozulabilir.


## Nabız oksimetrisi izleme – Masimo SET (M-LNCS)

### Masimo SET MCable

	Parça	Parça No.
<b>A</b>	Infinity MCable – Masimo SET	MS20667

### Masimo SET M-LNCS ara kabloları

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>B</b>	SpO2 Masimo M-LNC-4 kablosu 1,2 m (4 ft)	MP02988	MP03086
	SpO2 Masimo M-LNC-10 kablosu 3 m (10 ft)	MP02989	MP03087
	SpO2 Masimo M-LNC-14 kablosu 4,3 m (14 ft)	MP03208	MP03088



573



### Masimo tek hasta kullanımı M–LNCS sensörleri

Bu sensörlerin gerçekleştirdiği ölçümler SpO<sub>2</sub>, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>C</b>	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Aadx-3, 20 adet	MP02976	MP03071
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Pdx-3, 20 adet	MP02977	MP03072
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Inf-3, 20 adet	MP02978	MP03073
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, Neo-3, 20 adet	MP02979	MP03074
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS, NeoPt-3, 20 adet	MP02980	MP03075
	Masimo M–LNCS, numune paketi	MP02986	MP03079

#### NOT

<sup>1)</sup> PVI, sadece Masimo rainbow SET ile işler.

### Masimo yeniden kullanılabilen M–LNCS sensörler

Bu sensörlerin gerçekleştirdiği ölçümler SpO<sub>2</sub>, PI, PLS, PVI <sup>1)</sup>.

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
<b>D</b>	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS DCI, yetişkin	MP02981	MP03080
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS DCIP, çocuk	MP02982	MP03081
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS TC-I kulak	MP02983	MP03082
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS TF-I, yetişkin	MP02985	MP03083
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS YI çoklu alan	MP02984	MP03084
	SpO <sub>2</sub> Masimo M–LNCS DBI, yetişkin <sup>2)</sup>	MP03207	MP03085

#### NOT

<sup>1)</sup> PVI, sadece Masimo rainbow SET ile işler.

<sup>2)</sup> Masimo harekete ilişkin hiçbir iddiada bulunmaz.

## Masimo tek hasta kullanımlık M–LNCS travma sensörleri

	Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
E	Masimo M–LNCS travma sensörü, yetişkin	MP03206	MP03078
	Masimo M–LNCS travma sensörü, bebek/çocuk	MP03205	MP03077
	Masimo M–LNCS travma sensörü, yenidoğan	MP03204	MP03076


### DİKKAT

Travma sensörler kullanıldığında, sensör kapalyken tespit performansı bozulabilir.

## Masimo SpO2 aksesuarları

Parça	Parça No. (ABD dışı)	Parça No. (ABD)
Yapışkan SpO2 kare, 12 adet	7496875	MP03048
Petite sargı-yetişkin/ çocuk/yenidoğan	7496909	MP03047
Posey sargı, 12 adet	7496933	MP03045
Masimo YI için SpO2 sargı	7496917	MP03046
Masimo YI için SpO2 köpük sargı (12 adet)	7496891	MP03049
LNOP/LNCS TF-I için kafa bandı	MP03197	MP03050
Yapışkan ped LNOP/ LNCS TF-I	MP03198	MP03051
Masimo rainbow sensör kalkanı	MP03203	MP03070

## Nabız oksimetrisi izleme – Nellcor OxiMax



### NOT

Bu cihazın satın alınması, bu cihazı Nellcor tarafından üretilmemiş veya lisans verilmemiş herhangi bir oksimetre sensörüyle kullanmak için Nellcor'un herhangi bir patenti kapsamındaki açık veya örtük bir lisans bulunmasını gerektirmez.

### Nellcor SpO2 kabloları

	Parça	Parça No.
A	Infinity MCable – Nellcor OxiMax	MS20668
B	Nellcor ara kablo, 1,2 m (3,9 ft)	MP00748
	Nellcor ara kablo, 3 m (9,8 ft)	MS20979

### Nellcor tek hastada kullanılabilen sensörler

Aşağıdaki tabloda, Dräger'den satın alınabilecek uyumlu sensörler listelenmektedir.


	Parça	Parça No.
C	OxiMax MaxA, 46 cm (18 inç), 24 adet	MX50065
	OxiMax MaxAL, 91 cm (36 inç), 24 adet	MX50071
	OxiMax MaxI, bebek, 24 adet	MX50067
	OxiMax MaxN, yenidoğan/ yetişkin, 24 adet	MX50068

<b>C</b>	OxiMax MaxP, çocuk, 24 adet	MX50066
	Nellcor, OxiMax Max-R	MX50069
	Nellcor DURA-Y SpO2 sensörü, D-YS	MX01004
	Nellcor SpO2 sensörü, OxiMax Max-Fast, 24 adet	MX50070
	OxiBand Oxi-P/I, çocuk/bebek, 100 adet	2170221
	Nellcor Oxiband sargı A/N, 100 adet	8201012

### **Nellcor yeniden kullanılabilir sensör**

	<b>Parça</b>	<b>Parça No.</b>
<b>D</b>	Durasensor DS100A, yetişkin, parmak	7262764

## Kardiyak (C.O.) çıkış izleme



## C.O. kablolar, kateterler ve termistörler

	Parça	Parça No.
A	M540 Hemo Connect kablosu, 1,5 m (4,9 ft)	MS23897
	M540 Hemo Connect kablosu, 2,9 m (9,5 ft)	MS23898
B	MPOd - QuadHemo	MS20725
	Hemo2 pod (gösterilmiyor)	4319435
	Hemo4 pod (gösterilmiyor)	4315961
C	Ara kablo, 1 m (3,3 ft)	3368458
D	Ara kablodan katetere	8419160
E	Termistör kablosu, Argon/BD	8420077
F	Termistör T parçası, 25 adet	5741975
G	Termistör kablosu, Baxter-Edwards	8539983


## Kardiyak çıkış kitleri (gösterilmemiştir)

Parça	Parça No.
Kardiyak çıkış kiti, Baxter <sup>1)</sup>	7265155
Kardiyak çıkış kiti, Argon/BD <sup>1)</sup>	7265163

## NOT

<sup>1)</sup> Kit ara kablo, kateter kablosu ve termistör kablosu içerir.

## CO2 monitörizasyonu



### CO2 kabloları

	Parça	Parça No.
A	MCable – ana akış CO2	6871950
B	Y-kablosu CO2 ve analog/senk <sup>1)</sup>	MS22259

#### NOT

<sup>1)</sup> Y kablo MCable – ana akış CO2 ve MCable – Analog/Senk'in eşzamanlı kullanılmasını sağlar.

### Tek kullanımlık havayolu adaptörleri

	Parça	Parça No.
C	Havayolu adaptörü ana, yetişkin	MP01062
	Havayolu adaptörü ana, çocuk	MP01063


### Yeniden kullanılabilir havayolu adaptörleri

	Parça	Parça No.
C	Havayolu adaptörü ana, yetişkin	6870279
	Havayolu adaptörü ana, çocuk	6870280

### Ek aksesuarlar (gösterilmemiştir)

Parça	Parça No.
Kalibrasyon seti	8412710
CO2 test gazı silindiri	6850435
CO2 sensörü için park tutucu	8416352
Test filtresi	6870281

## Sıcaklık izleme



### Sıcaklık kabloları

	Parça	Parça No.
A	1/4 inç konektörlü sıcaklık probu için 7 pinli konektöre sahip adaptör kablosu	5198333
	Çift sıcaklık Y kablosu, 7 pinli	5592154

### Cilt problemleri

#### UYARI

Sıcaklık cilt problemleri, elektrocerrahide kullanılmaya yönelik değildir.

#### Yetişkin yeniden kullanılabilir

	Parça	Parça No.
B	Sıcaklık cilt probu, 1,5 m (4,9 ft)	4329822
	Sıcaklık cilt probu, 3 m (9,8 ft)	5204669

#### Yetişkin tek hastada kullanılabilen

	Parça	Parça No.
C	Sıcaklık cilt probu, yetişkin, 1,6 m (5,2 ft)	MP00995
	Sıcaklık cilt probu, yetişkin, 3 m (9,8 ft)	MP00996

#### Çocuk/yenidoğan tek hastada kullanılabilen

	Parça	Parça No.
C	Sıcaklık cilt probu, çocuk, 1,6 m (5,2 ft)	MP00997
	Sıcaklık cilt probu, çocuk, 3 m (9,8 ft)	MP00998

## Sıcaklık kabloları

	Parça	Parça No.
A	1/4-inç konektörlü sıcaklık probu için 7 pinli konektöre sahip adaptör kablosu	5198333
	Çift sıcaklık Y kablosu, 7 pinli	5592154

## Genel amaçlı problar

### UYARI


Sıcaklık probu kapaklarında lateks bulunur.

### NOT

İçeriye yerleştirilmiş yeniden kullanılabilir sıcaklık problarını sıcaklık probu kılıflarıyla örtün.


## Yetişkin genel amaçlı problar

	Parça	Parça No.
B	Sıcaklık probu, yetişkin, 1,5 m (4,9 ft)	4329889
	Sıcaklık probu, yetişkin, 3 m (9,8 ft)	5204644
C	Çekirdek probu kapakları, 20 cm, 10 adet (lateks içerir).	7014616



488





### Çocuk genel amaçlı probalar

	Parça	Parça No.
B	Sıcaklık probu, çocuk 1,5 m (4,9 ft)	4329848
	Sıcaklık probu, çocuk 3 m (9,8 ft)	5204651

### Yetişkin tek hastada kullanılabilen genel amaçlı probalar

D	Sıcaklık probu, yetişkin, 1,6 m (5,2 ft)	MP00991
	Sıcaklık probu, yetişkin, 3 m (9,8 ft)	MP00992

### Çocuk tek hastada kullanılabilen genel amaçlı probalar

D	Sıcaklık probu, çocuk 1,6 m (5,2 ft)	MP00993
	Sıcaklık probu, çocuk 3 m (9,8 ft)	MP00994

#### NOT

1) Sıcaklık çekirdek problemleri, elektrocerrahi sırasında ve özofageal ve rektal uygulamalarda kullanılabilir.

#### NOT

7 pin konektörlü sıcaklık problemleri Hemo4 pod, Hemo2 pod, MPod – QuadHemo ile uyumludur (bkz. sayfa 26).


## MCable – Analog/Senk

### Analog/senk kabloları

	Parça	Parça No.
<b>A</b>	Y-kablosu CO <sub>2</sub> ve analog/senk <sup>1)</sup>	MS22259
<b>B</b>	MCable – Analog/Senk	MS20662
<b>C</b>	Analog çıkış kablosu, 5 m (16,4 ft)	4314618
	QRS senk çıkış kablosu, 3 m (9,8 ft)	4314667

#### NOT

<sup>1)</sup> Y kablo MCable – ana akış CO<sub>2</sub> ve MCable – Analog/Senk'in eşzamanlı kullanılmasını sağlar.



171

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır.

Bu kullanma kılavuzu sadece şunlar için geçerlidir

**Infinity Acute Care System – İzleme Aksesuarları SW VG4.n**

Seri No.:

Dräger tarafından Seri No belirtilmemişse, bu Kullanma Kılavuzu yalnızca genel bilgi verme amaçlı sunulmuştur ve özel bir makine veya ünite için kullanılamaz.

Bu belge sadece müşteriye bilgilendirmek amacıyla sağlanmıştır ve müşteri talep etmedikçe güncellenmeyecek veya değiştirilmeyecektir.



93/42/AET no.lu Direktif  
tıbbi ürünlerle ilgili

İmalatçı

**Dräger Medical Systems, Inc.**  
3135 Quarry Road  
Telford, PA 18969-1042  
U.S.A.  
(215) 721-5400  
(800) 4DRAGER  
(800 437-2437)  
FAKS (215) 723-5935  
<http://www.draeger.com>

**EC REP** Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Latin  
Amerika, Asya Pasifik dağıtıcısı:

**Drägerwerk AG & Co. KGaA**  
Moislinger Allee 53 – 55  
D-23542 Lübeck  
Almanya  
+49 451 8 82-0  
FAKS +49 451 8 82-20 80  
<http://www.draeger.com>

**MS31125** – RI01 tr  
© Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Sürüm: 1 – 2014-10



Dräger, ekipman üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.