

**DE - Hexan 100/a (67 28 391) Dräger-Röhrchen®****WARNUNG**

Röhrcheninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen.

**1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen**

Bestimmung von n-Hexan in Luft oder technischen Gasen.

Messbereich : 100 bis 3000 ppm  
Hubzahl (n) : 6  
Dauer der Messung : ca. 3min  
Standardabweichung : ± 15 % bis 20 %  
Farbumschlag : orange → grün-braun  
Messbereichserweiterung : 50 bis 1500 ppm (n = 11),  
Skalenwert durch 2 dividieren.

Temperatur : 15 °C bis 35 °C  
Feuchtigkeit: 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L entspr. ca. 50% r.F. bei 22 °C)  
Korrekturfaktor: F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa).

**2 Reaktionsprinzip**

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + div. Oxydationsprodukte

**3 Voraussetzungen**

Die Funktionsweise der Röhrchen und der Dräger-Röhrchen Pumpen sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer Pumpen kann die ordnungsgemäße Funktion der Röhrchen gefährden. **Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten.** Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

**4 Messung durchführen und auswerten****WARNUNG**

Alle Spitzen des Röhrchens müssen abgebrochen sein, sonst ist eine Messung nicht möglich. Beim Einsetzen des Röhrchens muss der Pfeil zur Pumpe zeigen. Bei der Messung können geringe Mengen Schwefelsäureaerosole freigesetzt werden. Diese können reizend wirken. Einatmen vermeiden.

1. Beide Spitzen des Röhrchens im Dräger-Röhrchen-Öffner abbrechen.
2. Röhrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
3. Luft- oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
4. Gesamte Länge der Verfärbung ablesen.
5. Wert mit dem Faktor F für die Luftdruckkorrektur multiplizieren.
6. Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.  
1 ppm Hexan = 3,58 mg Hexan/m<sup>3</sup>  
1 mg Hexan/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm Hexan (bei 20 °C, 1013 hPa)

**5 Quersensibilitäten**

Alkohole, Ester, Aromaten, Benzinkohlenwasserstoffe und Ether werden ebenfalls angezeigt, jedoch alle mit unterschiedlicher Empfindlichkeit. Eine Differenzierung ist nicht möglich.

**6 Weitere Informationen**

Auf der Verpackungsbänderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben.

**HINWEIS**

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Röhrchen nicht mehr verwenden. Röhrchen gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

**EN - Hexane 100/a (67 28 391) Dräger-Tube®****WARNING**

The tube content is toxic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinters may come off.

**1 Application range/Ambient conditions**

Determination of n-hexane in air or technical gases.

Measuring range : 100 to 3000 ppm  
Number of strokes (n) : 6  
Measuring time : approx. 3 min  
Standard deviation : ± 15 % to 20 %  
Color change : orange → greenish-brown  
Extension of the measuring range : 50 to 1500 ppm (n = 11),  
Divide the scale value by 2.  
Temperature : 15 °C/59 °F to 35 °C/95 °F  
Humidity: 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L corresp. to 50 % r.h. at 22 °C)  
Correction factor: F = 1013 hPa (14.692 psi)/actual atmospheric pressure.

**2 Principle of reaction**

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + various oxidation products

**3 Requirements**

The Dräger tubes and the Dräger tube pumps work in a coordinated manner. Proper functioning of the tubes may be impaired when used with other pumps.

**Observe the instructions for use of the pump (Leak test!).** The measured value is applicable only to the place and date of measurement.

**4 Measurement and evaluation****WARNING**

All tips must be broken off, otherwise measuring is impossible. When inserting the tube, the arrow must point towards the pump. Small amounts of sulphuric acid aerosols may be released during the measurement. They may have an irritant effect. Do not inhale.

1. Break off both tips of the tube in the Dräger tube opener.
2. Insert the tube tightly in the pump. Arrow points towards the pump.
3. Suck air or gas sample through the tube.
4. Read the entire length of the discoloration.
5. Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric pressure.
6. Flush the pump with air after operation.  
1 ppm hexane = 3,58 mg hexane/m<sup>3</sup>  
1 mg hexane/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm hexane (at 20 °C, 1013 hPa)

**5 Cross sensitivities**

Alcohols, ester, aromates, petroleum hydrocarbons and ether are also indicated, however, all of them with differing sensitivity. Differentiation is not possible.

**6 Additional information**

The package strip indicates order number, shelf life, storing temperature and serial number. State serial number for inquiries.

**NOTICE**

Do not use tubes after the durability has expired. Dispose of tubes in accordance with the local directives or return in packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

**FR - Hexane 100/a (67 28 391) Dräger Tube réactif®****AVERTISSEMENT**

Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiques/irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention, lors de l'ouverture, des éclats de verre peuvent être projetés.

**1 Domaine d'utilisation/Conditions ambiantes**

Détermination du n-hexane dans l'air ou les gaz techniques.

Plage de mesure : 100 à 3000 ppm  
Nombre de courses (n) : 6  
Durée de la mesure : env. 3 minutes  
Ecart type : ± 15 % à 20 %  
Changement de couleur : orange → vert-marron  
Augmentation de la plage de mesure : 50 à 1500 ppm (n = 11),  
Diviser la valeur d'échelle par 2.  
Température : 15 °C à 35 °C  
Humidité : 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L correspond à env. 50 % d'humidité relative à 22 °C)  
Facteur de correction : F = 1013/presion atmosphérique réelle (hPa).

**2 Principe de réaction**

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + div. produits d'oxydation

**3 Conditions**

Le mode de fonctionnement des tubes et celui des pompes pour tubes Dräger sont adaptés l'un à l'autre. L'utilisation d'autres pompes peut altérer le fonctionnement correct des tubes réactifs.

**Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !).** La valeur de mesure n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

**4 Analyse et évaluation du résultat****AVERTISSEMENT**

Toutes les pointes des tubes réactifs doivent être cassées, sinon, une mesure est impossible. En insérant le tube réactif, la flèche doit être dirigée vers la pompe. Un petit aérosol composé d'acide sulfurique peut se dégager lors de la mesure. Cet aérosol peut causer des irritations. Eviter toute inspiration.

1. Casser les deux pointes du tube réactif dans le dispositif d'ouverture des tubes.
2. Insérer fermement le tube dans la pompe, la flèche imprimée se dirigeant vers la pompe.
3. Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube.
4. Evaluer la longueur totale de la coloration.
5. Multiplier la valeur obtenue par le facteur F de correction de pression atmosphérique.
6. Après utilisation, purger la pompe à l'air.  
1 ppm hexane = 3,58 mg hexane/m<sup>3</sup>  
1 mg hexane/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm hexane (à 20 °C, 1013 hPa)

**5 Sensibilités transversales**

Des alcools, l'ester, des composés aromatiques, des hydrocarbures de benzène et l'éther sont aussi affichés mais tous avec des sensibilités différentes. Une différenciation est impossible.

**6 Informations complémentaires**

Sur la bandelette d'emballage figurent : code de commande, date de péremption, température de stockage et no de série. Indiquer ce dernier en cas de réclamations.

**REMARQUE**

Après dépassement de la date de péremption, ne plus utiliser les tubes réactifs. Eliminer les tubes réactifs selon les directives locales ou les restituer dans leur emballage. A stocker hors de portée des personnes non autorisées.

**ES - Hexano 100/a (67 28 391)****Tube de control Dräger®****ADVERTENCIA**

El contenido del tubo de control tiene propiedades tóxicas/corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la piel o los ojos. Tener cuidado al abrir, pueden saltar pequeños trozos de cristal.

**1 Campo de aplicación/condiciones ambientales**

Determinación de n-Hexano en aire o gases industriales.

Rango de medición : de 100 a 3000 ppm  
Número de carreras (n) : 6  
Duración de la medición : 3 minutos aprox.  
Desviación típica : ± 15 % a 20 %  
Cambio de la coloración : naranja → verde-marrón  
Ampliación del rango de medición : de 50 a 1500 ppm (n = 11),  
Dividir el valor de la escala entre 2.  
Temperatura : de 15 °C a 35 °C  
Humedad: 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L equivale aprox. a 50 % hum. rel. a 22 °C)  
Factor de corrección: F = 1013/presión atmosférica real (hPa).

**2 Principio de reacción**

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + div. productos de oxidación

**3 Condiciones**

Los modos de funcionamiento de los tubos y las bombas para tubos Dräger están coordinados entre sí. La utilización de otras bombas puede poner en riesgo el funcionamiento correcto de los tubos de control.

**Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba (¡Prueba de estanqueidad!).** El valor medido es válido únicamente para el sitio y la hora en que se efectúa la medición

**4 Realización y evaluación de la medición****ADVERTENCIA**

Todas las puntas de los tubos de control deben estar rotas porque sino no es posible realizar una medición. Al utilizar el tubo de control la flecha debe indicar hacia la bomba. En la medición se pueden liberar pequeñas cantidades de aerosoles de ácido sulfúrico. Estos pueden provocar irritaciones. Evitar respirarlos.

1. Romper ambas puntas del tubo en el abridor de tubos Dräger.
2. Insertar firmemente el tubo de control en la cabeza de la bomba. La flecha debe señalar hacia la bomba.
3. Aspirar la prueba de aire o gas a través del tubo de control.
4. Leer la indicación de la longitud total de la coloración.
5. Multiplicar el valor por el factor F para corregir la presión atmosférica.
6. Después de la medición, la bomba se debe limpiar con aire.  
1 ppm hexano = 3,58 mg hexano/m<sup>3</sup>  
1 mg hexano/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm hexano (a 20 °C, 1013 hPa)

**5 Sensibilidad cruzada**

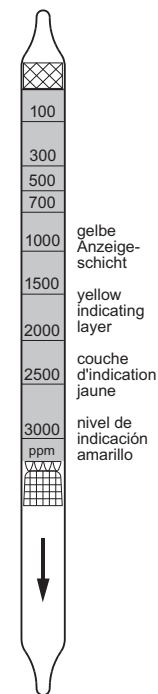
Los alcoholes, ésteres, aromáticos, hidrocarburos de gasolina y éteres también se muestran pero todos con diferente sensibilidad. No es posible diferenciar.

**6 Información adicional**

En la etiqueta del estuche están indicados: referencia, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y n° de fabricación. En caso de consultas, indiquen el n° de fabricación.

**NOTA**

Una vez superada la fecha de utilización, no utilizar más el tubo de control. Desechar los tubos de control según las directivas locales o devolverlos en su embalaje. Almacenar fuera del alcance de personas no autorizadas.

**Dräger**

## NL - Hexaan 100/a (67 28 391) Dräger-Tube®

### WAARSCHUWING

De inhoud van het buisje is toxisch en etsend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters losraken.

### 1 Toepassingsgebied/omgevingscondities

Vaststellen van n-hexaan in lucht of technische gassen.

Meetbereik : 100 tot 3000 ppm

Aantal pompeslagen (n) : 6

Duur van de meting : ca. 3 minuten

Standaardafwijking : ± 15 % tot 20 %

Kleuromslag : oranje → groen-bruin

Uitbreiding van het meetbereik : 50 tot 1500 ppm (n = 11),

meetbereik : Schaalwaarde door 2 delen.

Temperatuur : 15 °C tot 35 °C

Vochtigheid: 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L gelijk aan 50 % r.l. bij 22 °C)

Correctiefactor: F = 1013/werkelijke luchtdruk (hPa).

### 2 Reactieprincipe

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + div. oxidatieproducten

### 3 Voorwaarden

De werkwijze van de buisjes en van de Dräger buisjespomp zijn op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de correcte werking van de buisjes in gevaar brengen.

**Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest!) lezen.** De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

### 4 Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetresultaat

#### WAARSCHUWING

Alle uiteinden van de buisjes moeten afgebroken zijn, anders is een meting niet mogelijk. Bij het plaatsen van het buisje moet de pijl naar de pomp wijzen. Bij de meting kunnen geringe hoeveelheden zwavelzuuraerosol vrijkomen. Deze kunnen een irriterende werking hebben. Inademing vermijden.

1. Beide uiteinden van het buisje afbreken in de Dräger buisjesopener.
2. Buisje goed afsluitend in de pomp plaatsen. Pijlen wijzen naar de pomp.
3. Lucht- of gasmonster door het buisje zuigen.
4. Gehele lengte van de verkleuring aflezen.
5. Waarde met de factor F voor de luchtdrukcorrectie vermenigvuldigen.
6. Pomp na gebruik met lucht spoelen.  
1 ppm hexaan ≈ 3,58 mg hexaan/m<sup>3</sup>  
1 mg hexaan/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm hexaan (bij 20 °C, 1013 hPa)

### 5 Specificiteit (kruisgevoeligheid)

Alcoholen, esters, aromaten, benzinekoelwaterstoffen en ether worden ook aangetoond, maar alle met verschillende gevoeligheid. Een differentiatie is niet mogelijk.

### 6 Verdere informatie

Op de verpakkingbanderol worden het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de bewaartemperatuur en het serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serienummer op te geven.

### AANWIJZING

Na het verlopen van de gebruiksdatum buisjes niet meer gebruiken. Buisjes conform de plaatselijke richtlijnen afvoeren of in de verpakking retourneren. Veilig opstaan ter voorkoming van gebruik door onbevoegden.

## DA - Hexan 100/a (67 28 391) Drägerør®

### ADVARSEL

Rørets indhold har toksiske/ætsende egenskaber, må ikke indtages, undgå hud- eller øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, der kan springe glassplinter af.

### 1 Anvendelsesområde/omgivelsesbetingelser

Måling af n-hexan i luft eller tekniske gasser.

Måleområde : 100 til 3000 ppm

Antal pumpeslag (n) : 6

Måletid : ca. 3 minutter

Standardafvigelse : ± 15 % til 20 %

Farveændring : orange → grøn-brun

Udvidelse af måleområde : 50 til 1500 ppm (n = 11),

måleområde : Dividér skalaværdien med 2.

Temperatur : 15 °C til 35 °C

Fugtighed: 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L svarer til ca. 50 % rel. fugt. ved 22 °C)

Korrekturfaktor: F = 1013/aktuelt lufttryk (hPa).

### 2 Reaktionsprincip

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + div. oxydationsprodukter

### 3 Forudsætninger

Rørens og Dräger-rør-pumpenes funktion er afstemt efter hinanden. Anvendelse af andre pomper kan bringe rørens korrekte funktion i fare.

**Se brugsanvisningen til pumpen (tæthedstest!).** Den aflæste værdi er en øjeblikskoncentration.

### 4 Måling og analyse

#### ADVARSEL

Alle rørets spidser skal være knækkede, da en måling ellers ikke er mulig. Når røret sættes i, skal pilen pege mod pumpen. Ved målingen kan der blive frigivet mindre mængder svovlsyre-aerosoler. De kan virke irriterende. Undgå indånding.

1. Begge spidser knækkes af røret ved hjælp af rørbøneren.
2. Røret sættes tæt ind i pumpen. Pilene viser mod pumpen.
3. Luft- eller gasprøven suges igennem røret.
4. Aflæs hele farveændringens længde.
5. Værdien ganges med faktor F for lufttryksjustering.
6. Skyl pumpen med luft efter brug.  
1 ppm hexan ≈ 3,58 mg hexan/m<sup>3</sup>  
1 mg hexan/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm hexan (ved 20 °C, 1013 hPa)

### 5 Interfererende stoffer

Alkohol, estere, aromater, benzinkulbriente og æter vises ligeledes, dog alle med forskellig følsomhed. En differentiering er ikke mulig.

### 6 Øvrige informationer

Bestillingsnummer, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur og serienummer fremgår af banderollen på emballagen. Angiv venligst serienummer ved henvendelse.

### BEMÆRK

Røret må ikke anvendes efter udløb af anvendelsesdatoen. Røret skal bortskaffes i henhold til nationale forskrifter eller returneres i emballagen. Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

## IT - Esano 100/a (67 28 391) Dräger-Tube®

### AVVERTENZA

Il contenuto delle fiale ha proprietà tossiche e corrosive, non inghiottirle, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro.

### 1 Campi d'impiego/condizioni ambientali

Determinazione di n-esano nell'aria o nei gas tecnici.

Campo di misurazione : da 100 a 3000 ppm

Numero di Aspirazioni (n) : 6

Durata della misurazione : 3 minuti circa

Variazione standard : ± 15 % - 20 %

Viraggio di colore : arancio → verdebruno

Estensione del campo di misurazione : da 50 a 1500 ppm (n = 11),

misurazione : dividere il parametro di scala per 2.

Temperatura : da 15 °C a 35 °C

Umidità: 5 - 12 mg H<sub>2</sub>O/L (10 mg H<sub>2</sub>O/L corrisp. a circa 50 % UR a 22 °C)

Fattore di correzione: F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa).

### 2 Principio di reazione

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + div. prodotti di ossidazione

### 3 Requisiti

Il modo di funzionamento delle fiale e delle pompe per fiale Dräger ne consente l'utilizzo congiunto. L'impiego di altri tipi di pompe può compromettere il corretto funzionamento delle fiale. **Osservare le istruzioni d'uso della pompa (test di tenuta!).** Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

### 4 Esecuzione e valutazione della misurazione

#### AVVERTENZA

Bisogna rompere tutte le punte delle fiale, altrimenti non è possibile effettuare una misurazione. Nel sistemare la fiala, la freccia deve essere rivolta verso la pompa. Durante la misurazione può succedere che si disperdano degli aerosol di acido solforico in quantità ridotte, che possono avere un effetto irritante. Evitare di inalari.

1. Rompere entrambe le punte della fiala nell'aprifiale Dräger. Inserire la fiala saldamente nella pompa.
2. Fissare bene la fiala nella pompa. Le frecce sono rivolte verso la pompa.
3. Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala.
4. Rilevare la lunghezza totale del tratto del viraggio.
5. Moltiplicare il valore per il fattore F per la correzione della pressione dell'aria.
6. Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.  
1 ppm esano ≈ 3,58 mg esano/m<sup>3</sup>  
1 mg esano/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm esano (a 20 °C, 1013 hPa)

### 5 Effetti di sensibilità trasversale

Gli alcoli, gli esteri, i composti aromatici, gli idrocarburi della benzina e gli eteri vengono altrettanto indicati, ma ciascuno con una sensibilità differente. Non è possibile una differenziazione.

### 6 Informazioni addizionali

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero d'ordinazione, data di scadenza, temperatura di conservazione e numero di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di serie.

### NOTA

Dopo la data di scadenza non utilizzare più la fiala. Smettere le fiale attenendosi alle normative vigenti a livello locale oppure rispedite indietro nella loro confezione. Conservare le fiale al sicuro fuori dalla portata di persone non autorizzate.

## RU - Гексан 100/a (67 28 391) Dräger-Tube®

### ОСТОРОЖНО

Содержимое трубки токсично/агрессивно. Не принимайте внутрь, исключите контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла.

### 1 Область использования/условия окружающей среды

Определение содержания гексана в воздухе или технических газах.

Диапазон измерения : 100 - 3000 ppm

Число качков (n) : 6

Время измерения : прил. 3 мин.

Стандартное отклонение : ± 15 % - 20 %

Изменение цвета : оранжевый → зелено-коричневый

Расширение диапазона измерения : 50 - 1500 ppm (n = 11)

Разделите цену деления шкалы на 2.

Температура : 15 °C ... 35 °C

Влажность: 5 - 12 мг H<sub>2</sub>O/L (10 мг H<sub>2</sub>O/L соотв. 50 % отн. влажн. при 22 °C)

Поправочный коэффициент: F = 1013/фактическое давление воздуха (гПа).

### 2 Принцип реакции

C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> + Cr (VI) → Cr (III) + разл. продукты окисления

### 3 Условия

Принципы действия индикаторных трубок и насосов Dräger для трубок взаимно согласованы. Использование других насосов может повредить надлежащему функционированию индикаторных трубок. **Соблюдать инструкцию по эксплуатации насоса (испытание на герметичность!).** Полученные результаты действительны только в месте и в момент измерения.

### 4 Измерение и оценка результатов

#### ОСТОРОЖНО

Все концы индикаторных трубок следует обломать, иначе измерение провести невозможно. При использовании индикаторной трубки стрелка должна быть направлена в сторону насоса. При измерении возможно выделение незначительного количества аэрозолей серной кислоты, которые могут привести к раздражению. Избегайте вдыхания.

1. Отломайте оба конца трубки с помощью открывателя индикаторных трубок Dräger.
2. Плотно вставьте трубку в насос. Стрелка должна указывать на насос.
3. Прокачивайте пробу воздуха или газа через трубку.
4. Считайте всю длину окраски.
5. Умножьте значение на коэффициент F для поправки на атмосферное давление.
6. После измерения прокачайте насос чистым воздухом.  
1 ppm гексана = 3,58 мг гексана/m<sup>3</sup>  
1 мг гексана/m<sup>3</sup> = 0,28 ppm гексана (при 20 °C, 1013 гПа)

### 5 Перекрестная чувствительность

Также измеряются спирты, сложные эфиры, ароматические соединения, углеводороды нефти и сложные эфиры, но с различной чувствительностью. Их невозможно различить.

### 6 Дополнительная информация

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах указывайте серийный номер.

### УКАЗАНИЕ

После истечения срока годности трубку больше не использовать. Утилизацию индикаторных трубок производить в соответствии с местными нормативными документами или возвращать их в упаковке. Хранить в месте, недоступном для посторонних.

# Dräger

